



Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
*Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport*

Contra expertise op bepalingen van **radioactiviteit** in afvalwater en ventilatielucht van Urenco Nederland B.V.

Periode 2023 en 2024

**Contra expertise op bepalingen van
radioactiviteit in afvalwater en
ventilatielucht van Urenco Nederland B.V.**

Periode 2023 en 2024

RIVM-briefrapport 2025-0066

Colofon

© RIVM 2025

Delen uit deze publicatie mogen worden overgenomen op voorwaarde van bronvermelding: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de titel van de publicatie en het jaar van uitgave.

DOI 10.21945/RIVM-2025-0066

P.J.M. Kwakman (auteur), RIVM

Contact:

P.J.M. Kwakman

Milieu en Veiligheid\Centrum Veiligheid

Pieter.kwakman@rivm.nl

Dit onderzoek werd verricht in opdracht van Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS), in het kader van project 390220/24/CE, Contra Expertise Site Monitoring Straling

Dit is een uitgave van:

**Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu**

Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven

Nederland

www.rivm.nl

Publiekssamenvatting

Contra expertise op bepalingen van radioactiviteit in afvalwater en ventilatielucht van Urenco Nederland B.V.

Periode 2023 en 2024

De uranium verrijkingsfaciliteit van Urenco Nederland (UNL) meet hoeveel radioactiviteit het naar de omgeving loost via het eigen afvalwater en de ventilatielucht. UNL neemt hiervoor zelf de te analyseren monsters verspreid over het jaar, in dit rapport betreft het 2023 en 2024. Het RIVM verifieert deze afvalwatermetingen acht keer per jaar en de ventilatieluchtmetingen vijf keer per jaar.

De totaal-alfa, totaal-bèta resultaten en de gamma-analyses van afvalwater uit de contra expertise komen goed overeen. Uit de metingen blijkt dat de activiteitsconcentraties in afvalwater in zowel 2023 als 2024 meestal zeer laag zijn.

De radioactiviteit in ventilatielucht ligt zeer dicht bij het niveau van de hoeveelheid radon die van nature in de buitenlucht zit. De resultaten van de meetwaarden van UNL in ventilatielucht kwamen redelijk overeen met de RIVM-analyses.

In buitenlucht wordt de natuurlijke totaal-alfa en bèta-activiteit veroorzaakt door radon-dochters, waarbij de verhouding tussen alfa en bèta ongeveer 1/5 is. De verhouding die in de ventilatielucht is gevonden komt hiermee overeen. De verhouding zou heel anders zijn wanneer uranium vrijkomt; dan ligt de verhouding tussen alfa en bèta veel dichterbij 1/1. De gemeten verhouding kwam overeen met de natuurlijke verhouding totaal-alfa- en totaal-bèta activiteit. Daarom is het aannemelijk dat er in de bemonsteringsperiodes in 2023 en 2024 geen uranium via ventilatielucht is vrijgekomen.

RIVM voert de contra expertises jaarlijks uit in opdracht van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS).

Kernwoorden: UNL, radioactiviteit, lozingen, afvalwater, ventilatielucht

Synopsis

Counterchecks on measurements of radioactivity in waste water and ventilation air at Urenco Nederland B.V.

Period 2023-2024

The uranium enrichment facility operated by Urenco Nederland (UNL) measures the quantity of radioactivity it discharges to the environment via its own waste water and ventilation air. UNL takes the samples to be analysed at intervals throughout the year, in this report the period 2023 and 2024. RIVM checks these waste water measurements eight times a year and the ventilation air measurements five times a year. RIVM uses these counterchecks to verify the analyses performed by UNL.

In 2023 and 2024 the gross alpha and bèta results and the gamma analyses of wastewater in the counterchecks are consistent with the results found by UNL. The measurements show that the activity concentrations in waste water in the samples generally are very low.

The radioactivity in ventilation air is very close to the level of radon naturally present in outdoor air. The results of the values measured by UNL in ventilation air are reasonably consistent with the RIVM analyses.

The natural gross alpha and gross bèta activity found in outdoor natural air is caused by radon daughters, as is demonstrated by the ratio of approximately 1/5 for gross alpha versus gross bèta activity. The ratio found in the samples was consistent with this natural ratio, but would be completely different if uranium had been released. The measured ratio corresponds with the ratio found in natural outdoor air. It is therefore reasonable to assume that no uranium was released through ventilation air in all five sampling periods in 2023 and similarly in 2024.

The Authority for Nuclear Safety and Radiation Protection (ANVS) commissions RIVM to carry out these counterchecks every year.

Keywords: UNL, radioactivity, discharges, waste water, ventilation air

Inhoudsopgave

Samenvatting — 9

1 Inleiding — 11

- 1.1 Opdracht en rapportindeling — 11
- 1.2 Herkomst data van UNL en autorisatie van deze rapportage — 11
- 1.3 Opdrachtgever ANVS en opdrachtnemer RIVM — 11
- 1.4 Kwaliteitsborging — 12
- 1.5 Disclaimer met betrekking tot de scope van accreditatie — 12

2 Monsters en analyses — 13

3 Analysemethoden — 15

- 3.1 Tweevoudbepalingen — 15
- 3.2 Bepaling van de totaal-alfa activiteitsconcentratie en totaal-bèta activiteitsconcentratie in afvalwater — 15
- 3.3 Bepaling van het gehalte aan gammastraling uitzendende nucliden in afvalwater — 16
- 3.4 Bepaling van de totaal-alfa en totaal-bèta activiteitsconcentratie in ventilatielucht — 16
- 3.5 Bepaling van het gehalte aan gammastraling uitzendende nucliden in ventilatielucht — 17
- 3.6 Onzekerheidsberekening — 17
- 3.7 Presentatie van resultaten en vergelijking — 18

4 Resultaten en discussie — 21

- 4.1 Herkomst data van UNL — 21
- 4.2 Vergelijking van de resultaten en discussie — 21
- 4.3 Afvalwater – 2023 — 21
- 4.4 Ventilatielucht 2023 — 24
- 4.5 Afvalwater 2024 — 24
- 4.6 Ventilatielucht 2024 — 26
- 4.7 Radonexhalatie uit de betonnen verrijkingshallen — 26
- 4.8 Oordeel over de resultaten 2023 en 2024 — 29

5 Bijlage A Vergelijking met meetresultaten UNL in 2023 — 31

6 Bijlage B Vergelijking met meetresultaten UNL in 2024 — 34

7 Bijlage C UNL analyse van afvalwatermonsters voor lozing op het riool — 37

8 Bijlage D Analyse van ventilatielucht door UNL — 45

9 Bijlage E RIVM schatting van radon exhalatie van UNL fabriekshallen; situatie in 2019 — 46

Referenties — 47

Samenvatting

Het Centrum Veiligheid (VLH) van RIVM heeft in 2023 en 2024 in opdracht van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) radioactiviteitsmetingen uitgevoerd van lozingsmonsters afkomstig van een zestal nucleaire installaties in Nederland. Het doel is het leveren van contra expertise op de metingen die door de installaties zelf zijn uitgevoerd. Dit rapport gaat over monsters genomen door Urenco Nederland B.V. te Almelo in de periode 2023 en 2024.

Het betreft zowel afvalwatermonsters als filters waarmee uitgaande ventilatielucht van verschillende gebouwen is bemonsterd. Het RIVM heeft de activiteitsconcentratie van totaal-alfa, totaal-bèta en gammastralers bepaald in afvalwatermonsters en ventilatielucht. De mate van overeenstemming tussen de resultaten van RIVM en die van de nucleaire installaties wordt ingedeeld in vier categorieën, in afnemende volgorde A1, A2, B en C. Doorgaans komen de afvalwateranalyses overeen met de resultaten van UNL.

De totaal-alfa, totaal-bèta resultaten en de gamma-analyses van afvalwater uit de contra expertise in 2023 en 2024 komen goed overeen.

Uit de metingen blijkt dat de activiteitsconcentraties in afvalwater in 7 van de 8 monsters laag zijn: lager dan $0,6 \text{ kBq}\cdot\text{m}^{-3}$ voor totaal-alfa en lager dan $0,7 \text{ kBq}\cdot\text{m}^{-3}$ voor totaal-bèta. In een monster van 2023 was de activiteitsconcentratie zeer licht verhoogd: $16 \text{ kBq}\cdot\text{m}^{-3}$ voor totaal-alfa en $15 \text{ kBq}\cdot\text{m}^{-3}$ voor totaal-bèta. In 2024 was er eveneens een watermonster met een zeer lichte verhoogde activiteitsconcentratie: $4 - 5 \text{ kBq}\cdot\text{m}^{-3}$ voor totaal-alfa en voor totaal-bèta $5,5 - 6 \text{ kBq}\cdot\text{m}^{-3}$. De overeenstemming in de RIVM en UNL resultaten was goed.

De radioactiviteit in ventilatielucht ligt zeer dicht bij het niveau van de hoeveelheid radon die van nature in de buitenlucht aanwezig is. De resultaten van de meetwaarden van UNL in ventilatielucht kwamen redelijk overeen met de RIVM-analyses.

In buitenlucht wordt de totaal-alfa en bèta-activiteit veroorzaakt door radon-dochters, waarbij de verhouding tussen alfa en bèta ongeveer 1/5 is. De gemeten verhouding kwam overeen met de natuurlijke verhouding totaal-alfa- en totaal-bèta-activiteit. Daarom is het aannemelijk dat er in de bemonsteringsperiodes in 2023 en 2024 geen uranium via ventilatielucht is vrijgekomen.

RIVM voert de contra expertises jaarlijks uit in opdracht van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS).

1 Inleiding

1.1 Opdracht en rapportindeling

De afdeling SMA van het Centrum Veiligheid van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM/VLH) voert in opdracht van de ANVS radioactiviteitsmetingen uit van lozingsmonsters afkomstig van een zestal nucleaire installaties in Nederland. Het doel is het leveren van contra expertise op de metingen die door de installaties zelf zijn uitgevoerd. Dit rapport gaat over monsters afkomstig van Urenco Nederland B.V. (UNL) te Almelo uit de periode 2023 en 2024. Het betreft zowel afvalwatermonsters als filters waarmee de uitgaande ventilatielucht van verschillende gebouwen is bemonsterd.

De indeling van dit rapport is als volgt. Na deze inleiding volgt hoofdstuk 2 met een beschrijving van de voor de contra expertise gebruikte monsters en de hiervan bepaalde radioactieve eigenschappen. In hoofdstuk 3 staat een beschrijving van de door RIVM toegepaste analysemethoden en de wijze waarop de resultaten van RIVM met die van het onderzochte bedrijf zijn vergeleken. Hoofdstuk 4 bevat een korte bespreking van de resultaten van het contra expertiseonderzoek. De meetresultaten zelf zijn – naast de resultaten van het onderzochte bedrijf – opgenomen in Bijlage A (data 2023) en Bijlage B (data 2024). De bemonstering wordt door de onderzochte bedrijven uitgevoerd. Beschrijvingen van de bemonsterings- en analysemethoden toegepast door UNL zijn gereproduceerd in Bijlage C.

1.2 Herkomst data van UNL en autorisatie van deze rapportage

De meetgegevens van UNL die in deze rapportage zijn opgenomen zijn afkomstig uit de lozingsrapportages en kwartaalrapportages die UNL opstelt. Aanvullende gegevens die niet in de kwartaalrapportages staan, worden per e-mail verstuurd naar RIVM of bij het ophalen van de lozingsmonsters meegegeven.

De data van UNL staan in alle betreffende tabellen met een vet en cursieve header “***UNL***” weergegeven.

Autorisatie van dit rapport wordt in het RIVM publicatieproces afgehandeld. Vrijgave van het rapport gebeurt door het domeinhoofd M&V of diens aangewezen vervanger, via de aanbiedingsbrief aan de opdrachtgever.

1.3 Opdrachtgever ANVS en opdrachtnemer RIVM

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS, Koningskade 4, Den Haag; www.anvs.nl) heeft RIVM, centrum Veiligheid, afdeling Stralingsincidenten, Monitoring en Analyses (adres RIVM, Antonie van Leeuwenhoeklaan 9, 3721 MA Bilthoven) opdracht gegeven voor het uitvoeren van een contra expertise op de bepalingen van radioactiviteit in afvalwater en ventilatielucht door de nucleaire installaties KCB, COVRA, GKN, NRG, RID en UNL.

De ANVS projectnaam is ‘Contra Expertise Metingen Nucleaire Installaties’.

Met contra expertise wordt bedoeld een vergelijking tussen de RIVM meetwaarden en de meetwaarden van de betreffende nucleaire installatie, zoals beschreven in hoofdstuk 3.

Het radiologisch laboratorium van het RIVM, Centrum Veiligheid/SMA bevindt zich op hetzelfde adres in Bilthoven als boven vermeld.

1.4 Kwaliteitsborging

De afdeling SMA van het Centrum Veiligheid van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM/VLH) is voor een aantal verrichtingen geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie volgens NEN-EN-ISO 17025 [1] (RvA: L153 testen). Deze verrichtingen hebben betrekking op metingen die worden uitgevoerd in het kader van het toezicht op nucleaire installaties (ANVS) en zijn gemarkeerd met een 'Q'. Zie Tabel 1 in hoofdstuk 2.

In het kader van de bewaking van de kwaliteit van de gebruikte analyse- en meetmethoden neemt RIVM jaarlijks deel aan de ringonderzoeken 'Abwasser' en 'Fortluft', georganiseerd door het Duitse Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) [2, 3].

1.5 Disclaimer met betrekking tot de scope van accreditatie

De accreditatie betreft specifiek de analyseresultaten van de verrichtingen. De opinies/interpretaties vermeld in dit rapport vallen buiten de scope van de accreditatie.

Uitvoering van bemonstering door de klant of andere partij:

De resultaten van de bepalingen van RIVM zijn alleen van toepassing op de ontvangen monsters. Gegevens met betrekking tot de monsternamen, zoals de lozingsdatum en monsterperiode zijn aangeleverd door UNL middels kwartaalrapportages en bij het monster aangeleverde informatie. De kwaliteit van deze data valt onder de verantwoordelijkheid van UNL.

2 Monsters en analyses

RIVM voert zelf geen bemonstering uit van afvalwater en ventilatielucht, maar haalt periodiek afvalwater- en ventilatieluchtmonsters op bij Urenco Nederland B.V (UNL). De bemonstering wordt dus uitgevoerd door UNL.

Overzicht van de geanalyseerde monsters

Van het bemonsterde afvalwater houdt UNL circa 1 liter onbehandeld water apart voor het uitvoeren van contra expertise door RIVM. Voor het bepalen van de radioactiviteit in uitgaande ventilatielucht gebruikt UNL aerosolfilters. Deze zijn beschikbaar voor het RIVM nadat de metingen door UNL verricht zijn. Tabel 1 bevat een overzicht van het, met de ANVS afgesproken, aantal monsters en de te verrichten analyses per jaar [4].

Tabel 1 Overzicht van het aantal monsters en analyses per jaar

Monsters	Aantal	Soort monster	Analyses (Q*)
Afvalwater	8	Batchmonster	Q: Totaal-alfa **, totaal-bèta**, gammastralers*
Ventilatie-lucht	5 periodes op 5 locaties#; CSB, RCC, SP4, SP5 1MA5 en 2MA5	Aerosolfilters	Q: Totaal-alfa **, totaal-bèta**, indien totaal-bèta op filter > 0,5 Bq dan ook bepaling gamma-emitters**

Q De aanduiding Q betekent dat de betreffende verrichting valt onder de lijst van geaccrediteerde verrichtingen volgens NEN-EN-ISO-17025 (registratienummer L153 testen).

* Analyse door RIVM in enkelvoud, ** Analyse in tweevoud

CSB = Central Services Building; RCC = Recyclingcentre; SPx = Separation Plantx; 1MA5 en 2MA5 zijn de 2 ventilatieluchtstofbemonsteringsapparaten in SP5.

Het RIVM heeft op vier verschillende momenten bij UNL in 2023 de monsters opgehaald. (Tabel 2). De monsternamenpunten in 2023 zijn CSB, SP4 en SP5 voor de watermonsters, zie Tabel 2.

Tabel 2 Monstergegevens afvalwater; de ophaaldata in 2023 voor de ventilatieluchtfilters zijn gelijk aan de ophaaldata van afvalwater

Nr	Datum afvalwater	Ophaaldatum	Analysedatum alfa/bèta	Fabriek
1	12 januari	3 april	12 mei	SP4
2	7 februari	3 april	12 mei	SP5
3	14 juni	10 juli	1 augustus	SP5
4	23 juni	10 juli	1 augustus	SP5
5	14 augustus	31 augustus	1 november	SP5
6	21 augustus	31 augustus	1 november	SP4
7	18 oktober	23 november	26 januari '24	CSB
8	25 oktober	23 november	26 januari '24	SP5

In 2023 zijn ventilatieluchtfilters opgehaald bij UNL van SP4, SP5 (1MA5 en 2MA5), RCC en CSB; zie Tabel 3.

Tabel 3 Monstergegevens ventilatielucht; bemonsteringsperiodes en ophaaldata in 2023 voor de ventilatieluchtfilters van SP4, SP5 (1MA5 en 2MA5), RCC en CSB

Nr	Periode 2023	Ophaaldatum	Analysedatum
1	12 feb - 19 feb	3 apr	3 apr
2	28 mei - 04 jun	10 jul	19 jul
3	04 jun - 11 jun	10 jul	24 jul
4	23 jul - 30 jul	31 aug	8 sep
5	15 okt - 22 okt	23 nov	29 nov

In 2024 zijn watermonsters opgehaald bij UNL van RCC, SP4 en SP5; zie Tabel 4.

Tabel 4 Monstergegevens afvalwater; de ophaaldata in 2024 voor de ventilatieluchtfilters zijn gelijk aan de ophaaldata van afvalwater

Nr	Datum afvalwater	Ophaaldatum	Analysedatum	alfa/bèta	Fabriek
1	03 mrt	20 mrt	22 apr		SP5
2	05 apr	15 mei	23 jul		SP5
3	09 apr	15 mei	23 jul		RCC
4	14 jun	10 juli	30 jul		RCC
5	25 jun	10 juli	30 jul		SP5
6	20 aug	18 sep	17 dec		SP4
7	30 aug	18 sep	17 dec		SP5
8	25 nov	12 dec	12 feb '25		SP5

In 2024 zijn ventilatieluchtfilters opgehaald bij UNL van SP4, SP5 (1MA5 en 2MA5), RCC en CSB; zie Tabel 5.

Tabel 5 Monstergegevens ventilatielucht; bemonsteringsperiodes en ophaaldata in 2024 voor de ventilatieluchtfilters van SP4, SP5 (1MA5 en 2MA5), RCC en CSB

Nr	Periode 2024	Ophaaldatum	Analysedatum
1	11-18 feb	20 mrt	11 apr
2	26 mei-2 jun	10 jul	16 jul
3	2-9 jun	10 jul	17 jul
4	4-11 aug	18 sep	19 sep
5	3-10 nov	12 dec	19 dec

3 Analysemethoden

Het Centrum Veiligheid, afdeling SMA, van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM/VLH) is voor een aantal verrichtingen geaccrediteerd door de RvA volgens NEN-EN-ISO-17025 (registratienummer L153). Deze verrichtingen hebben betrekking op metingen die worden uitgevoerd in het kader van het toezicht op nucleaire installaties.

Indien mogelijk hanteert RIVM/VLH NEN-normen. Voor gammaspectrometrie wordt gewerkt conform NEN-EN-ISO 20042 [5]; voor gasdoorstroomtelling van filters wordt gewerkt conform NEN 5636 [6]. Voor de bepaling van de totaal-alfa en totaal-bèta activiteit in afvalwater heeft RIVM/VLH een methode als een eigen methode gevalideerd [7].

Beschrijvingen van de bemonsterings- en analysemethoden toegepast door UNL in 2023 en 2024, zijn gereproduceerd in Bijlage C en D. Deze methoden zijn gelijk aan de door UNL toegepaste methoden in het voorafgaande jaar [8].

In opdracht van de ANVS worden de randvoorwaarden uit de Kerntechnische Ausschuss (KTA-1503 [9] en KTA-1504 [10]) voor de uitvoering van de analyses aangehouden. Dit betreft bijvoorbeeld de samenstelling van de nuclidenbibliotheek en de detectiegrenzen die gehaald moeten kunnen worden.

3.1 Tweevoudbepalingen

Welke analyses in enkelvoud en welke in tweevoud worden uitgevoerd, staat in Tabel 1 in hoofdstuk 2. Het RIVM voert de analyses in afvalwater in tweevoud uit. Wanneer het verschil tussen de twee meetwaarden van een tweevoudbepaling groter is dan 4s (waarbij s de totale onzekerheid van de grootste van de twee meetwaarden is) wordt een tweevoudbepaling afgekeurd. In zo'n geval volgt een aanvullende controle, bijvoorbeeld een controle van de berekeningen, een herhaling van een meting of een nieuwe analyse met achtergehouden monstermateriaal. Het laatste gebeurt indien mogelijk bij afkeuring van een analyse op ^{60}Co of ^{137}Cs . Bij andere gammastralers dan ^{60}Co en ^{137}Cs worden in geval van een afgekeurde tweevoudbepaling de twee meetresultaten afzonderlijk gerapporteerd. Wordt het resultaat van een tweevoudbepaling niet afgekeurd, dan wordt het gemiddelde van de twee meetwaarden gerapporteerd. De analyses waarvan gedurende een langere periode gebleken is dat er weinig of geen afkeuringen plaatsvinden, worden uit oogpunt van efficiency in enkelvoud uitgevoerd.

3.2 Bepaling van de totaal-alfa activiteitsconcentratie en totaal-bèta activiteitsconcentratie in afvalwater

Na krachtig schudden wordt van het gehomogeniseerde monster in twee verschillende flesjes elk 10,0 ml gepipetteerd. Aan één van de flesjes wordt 0,100 ml van een natuurlijk uraniumoplossing met bekende

activiteitsconcentratie toegevoegd en goed gemengd. De twee oplossingen worden in gedeelten op roestvast stalen, geschuurde en ontvette telplaatjes met een diameter van 50 mm overgebracht en drooggedampt in een stoof bij 60-80 °C. De metingen aan beide telschaaltjes worden uitgevoerd met proportionele gasdoorstroomtellers die zijn voorzien van een dun venster ($< 0,5 \text{ mg}\cdot\text{cm}^{-2}$). De tellers hebben een lage achtergrond. De telopbrengst wordt berekend uit het verschil in de resultaten van de beide telpreparaten en de toegevoegde activiteit aan natuurlijk uranium.

Deze methode is vastgelegd in procedure VLH-H-005; Handboek Gasdoorstroomtelling.

3.3 Bepaling van het gehalte aan gammastraling uitzendende nucliden in afvalwater

Per analyse wordt van het afvalwater één monster van 250 ml afgemeten. Dit monster wordt in een teldoos gemengd met een geleermiddel en geschud tot een homogene stijve massa verkregen is. Dit 'geleren' dient ter voorkoming van het uitzakken van de radioactieve componenten bij gammaspectrometrische analyses met lange teltijden. Van het ontstane gegeleerde telpreparaat wordt over het energiebereik van 40 keV tot 2 MeV een gammaspectrum opgenomen met behulp van een P-type halfgeleiderdetector met hoge energieresolutie in combinatie met een pulssorteerder met 16384 kanalen. De meettijd is 1000 minuten. Het spectrum wordt geanalyseerd met behulp van het analyseprogramma Apex-Gamma (Mirion) aan de hand van een nuclidenbibliotheek; zie Bijlage A (Tabel A2). In deze nuclidenbibliotheek zijn nucliden uit de uranium- en thoriumreeksen opgenomen, met daaraan toegevoegd de nucliden ^7Be , ^{40}K , ^{60}Co en ^{137}Cs . Daarnaast wordt door het analyseprogramma melding gemaakt van pieken die wel gedetecteerd zijn in het spectrum maar die niet aan één van de in de bibliotheek opgenomen nucliden toe te wijzen zijn. Is dit het geval dan vindt een nadere analyse van het spectrum plaats. Het RIVM corrigeert voor radioactief verval door de activiteitsconcentratie van de gedetecteerde nucliden terug te rekenen naar de dag van bemonstering. Indien door het RIVM geen enkele gammastraler wordt aangetoond, wordt slechts de detectiegrens voor ^{234}Th gegeven.

Formeel vereist KTA 1504 [10] dat bij het meten van gammastraling uitzendende radionucliden in gedestilleerd water de detectiegrens voor ^{60}Co lager is dan $1 \text{ kBq}\cdot\text{m}^{-3}$. De metingen voldoen dus aan de randvoorwaarden uit KTA 1504. Bij het meten van afvalwater van UNL is er echter voor gekozen om de detectiegrens te geven van de bèta/gammastraler ^{234}Th , de met een halveringstijd van 24,1 d ingroeiende dochter van ^{238}U .

De energieafhankelijke telefficiëntie van de meetopstelling wordt gekalibreerd met het softwarepakket ISOCS van Mirion.

Deze methode is vastgelegd in VLH-H-004 Gamma-spectrometrie.

3.4 Bepaling van de totaal-alfa en totaal-bèta activiteitsconcentratie in ventilatielucht

Per analyse wordt uit een luchtstoffilter een schijf met een diameter van 46 mm geponst. Met behulp van een proportionele gasdoorstroomteller met een lage achtergrond, die van een dun venster ($< 0,5 \text{ mg}\cdot\text{cm}^{-2}$) is voorzien, wordt hiervan de alfa- en bèta-activiteit gemeten. In afwijking

van NEN 5636 [6] inzake de analyse van luchtstoffilters wordt voor de bepaling van de totaal-alfa en de totaal-bèta activiteitsconcentratie natuurlijk uranium als referentienuclide toegepast. Hiervoor is gekozen omdat er geen onbekende nucliden, maar uraan-isotopen worden geloosd bij Urenco. Aangezien de invloed van de stofbelading op de totaal-alfa efficiëntie aanzienlijk kan zijn en per monster onbekend, is in deze rapportage een onzekerheid van 30% in de waarde voor de totaal-alfa activiteitsconcentratie in ventilatielucht opgenomen. Deze methode is vastgelegd in procedure VLH-H-005; Handboek Gasdoorstroomtelling.

3.5 Bepaling van het gehalte aan gammastraling uitzendende nucliden in ventilatielucht

Voor de controle van de alfa-, bèta- en gamma-activiteiten wordt bij UNL de geloosde ventilatielucht, afkomstig uit de verschillende verrijkingfabrieken, door glasvezelfilters gezogen. De filters worden door UNL met behulp van alfa-bèta pseudocoïncidentie meetapparatuur continu gecontroleerd. Eénmaal per week worden de filters door UNL verwisseld. Uit elk te analyseren filter worden twee deelfilters met een diameter van 46 mm geponst. Met behulp van een gasdoorstroomteller wordt van de deelfilters eerst de alfa- en bèta-activiteit gemeten volgens de methode omschreven in handboek VLH-H-005. Indien de bèta-activiteit groter is dan 0,5 Bq, wordt een spectrum opgenomen van het deelfilter met de hoogste bèta-activiteit op een gammaspectrometrie-opstelling.

Deze methode is vastgelegd in VLH-H-004; Handboek Gammaspectrometrie.

3.6 Onzekerheidsberekening

De door RIVM opgegeven onzekerheid is het 1σ -schattingsinterval. Voor het bepalen hiervan is gebruik gemaakt van NEN 1047 [11] (Receptbladen voor de statistische verwerking van waarnemingen) en ISO/IEC 98 [12] (Nauwkeurigheid van metingen, termen en definities). Indien de analyse in tweevoud is uitgevoerd, wordt het gemiddelde en de onzekerheid daarin gerapporteerd. Bij het schatten van de totale onzekerheid worden telonzekerheden, kalibratieonzekerheden en experimentele onzekerheden meegenomen. Onder experimentele onzekerheden vallen bijvoorbeeld onzekerheden in wegingen en volumebepalingen.

Waar van toepassing, is voor de volumebepaling in de hoeveelheid bemonsterde lucht een onzekerheid van 1% opgenomen in de experimentele onzekerheid.

Een correctie voor de achtergrond is in alle gevallen meegenomen in de activiteitsberekening en in de onzekerheidsberekening.

Bepaling van de totaal-alfa activiteitsconcentratie en totaal-bèta activiteitsconcentratie in afvalwater

Hier wordt per analyse gebruikgemaakt van een preparaat zonder en een preparaat met een uranium-tracer, ieder met de eigen tel- en experimentele onzekerheden. De totale onzekerheid in de totaal-alfa-activiteitsconcentratie, respectievelijk totaal-bèta activiteitsconcentratie, is dan samengesteld uit een telonzekerheid van het preparaat bestaande uit het monster, een telonzekerheid van het preparaat bestaande uit het

monster inclusief de standaard, een kalibratieonzekerheid en een experimentele onzekerheid.

Bepaling van de totaal-alfa activiteitsconcentratie en totaal-bèta activiteitsconcentratie in ventilatielucht

Omdat bij de totaal-alfa bepaling de invloed van de stoflaag op de telefficiëntie groot kan zijn en per monster verschillend, wordt een onzekerheid van 30% in de berekening van de totale onzekerheid verwerkt.

De totale onzekerheid in de totaal-alfa- en totaal-bèta-activiteitsconcentratie in luchtstof is samengesteld uit een telonzekerheid van beide deelpreparaten, een kalibratieonzekerheid, een experimentele onzekerheid (inclusief de 1% onzekerheid als gevolg van het ponsen van een deel uit het gehele filter), en alleen voor totaal-alfa de stoflaagonzekerheid van 30%.

Gammaspectrometrie

Voor de gammastraling uitzendende nucliden vindt rapportage plaats met een aangegeven onzekerheid voortkomend uit telstatistiek, kalibratie, achtergrond en monstervoorbehandeling.

3.7 Presentatie van resultaten en vergelijking

Voor de vergelijking worden de door UNL bepaalde activiteitsconcentraties overgenomen uit de opgaven van UNL [13] en zijn in deze rapportageperiode rekenkundig afgerond met de regels zoals die door RIVM wordt gehanteerd (volgens NEN 1047 [11]).

In het kort: afronding vindt plaats met de grootste decimale eenheid (10; 1; 0,1 ; 0,01) onder 1/2 s. Voorbeeld : $48,42 \pm 0,58$. $\frac{1}{2} s = 0,29$; dus grootste decimale eenheid is 0,1. Afronding leidt tot $48,4 \pm 0,6$.

De overeenkomst tussen de meetresultaten van RIVM en die van de onderzochte nucleaire installatie (NI) wordt ingedeeld in één van de categorieën A1, A2, B, of C, die gekoppeld zijn aan een waarschijnlijkheid. Vergelijking vindt alleen plaats als zowel RIVM als de onderzochte NI een activiteit hebben aangetoond en opgegeven.

Het vergelijken van de gemeten waarden x_{NI} en x_{RIVM} is ook te verwoorden als het bepalen van het verschil $\Delta = x_{NI} - x_{RIVM}$. Het verschil tussen de meetwaarden wordt berekend uit de getallen zoals deze worden weergegeven, dus na afronding van de meetwaarde van RIVM (volgens NEN 1047 [11]). De onzekerheid in dit verschil is: $s_{\Delta} = \sqrt{(s_{NI}^2 + s_{RIVM}^2)}$.

Deze manier van vergelijken komt overeen met een z-test die gebruikelijk is in het beoordelen van resultaten in ringonderzoeken. De vergelijking, zoals in dit rapport wordt uitgevoerd, valt niet onder de scope van de accreditatie van de afdeling VLH/SMA.


Indien de NI geen opgave doet van de onzekerheid in het analysesresultaat, wordt verondersteld dat de onzekerheid in de meetwaarde van de NI, s_{NI} , gelijk is aan de onzekerheid in de meetwaarde van RIVM, s_{RIVM} .

In het ideale geval, bij een voldoende groot aantal metingen van hetzelfde monster, ligt het gemiddelde ten opzichte van de toevallige variaties zeer dicht bij de 'ware waarde' en komt de standaarddeviatie van de meetwaarden overeen met de opgegeven onzekerheden.

Als de spreiding benaderd kan worden met de normale verdeling (zie figuur), dan kunnen de volgende frequenties of waarschijnlijkheden van voorkomen van de categorieën verwacht worden:

- A1: $|\Delta| \leq s_{\Delta}$ ~68%, ofwel circa 2 uit 3 ("Goed")
 A2: $s_{\Delta} < |\Delta| \leq 2 s_{\Delta}$ ~27%, ofwel circa 1 uit 4 ("Goed")
 B: $2 s_{\Delta} < |\Delta| \leq 3 s_{\Delta}$ ~4,3%, ofwel circa 1 uit 20 ("Redelijk")
 C: $3 s_{\Delta} < |\Delta|$ ~0,26%, ofwel circa 1 uit 400 ("Matig")

Figuur 1 Schematische weergave van een Gauss verdeling

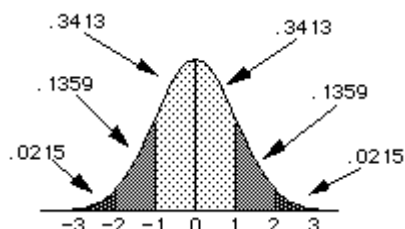

In de praktijk is er soms sprake van een inhomogene verdeling van activiteit in het monster waardoor rekening gehouden moet worden met meer voorkomen van de categorie C dan hierboven wordt gesuggereerd. Veel vaker dan verwacht voorkomen van B's en C's is een aanwijzing voor niet onderkende, mogelijk systematische, onzekerheden.

4 Resultaten en discussie

4.1 Herkomst data van UNL

Disclaimer - herkomst data en uitvoering van bemonstering.
RIVM heeft de meetdata van UNL overgenomen uit de lozingsrapportages en de kwartaal-rapportages [13]. De kwaliteit van deze data valt onder de verantwoordelijkheid van UNL. In de tabellen in de bijlagen zijn alle data die aangeleverd zijn door UNL gemarkeerd met “**UNL**”. De bemonstering van afvalwater en ventilatielucht is uitgevoerd door UNL. Monstergegevens, lozingsdatum en monsterperiode, zijn aangeleverd door UNL. De resultaten van de bepalingen van RIVM zijn alleen van toepassing op de ontvangen monsters.

In de tabellen in Bijlage A en B staan de meetonzekerheden (onzekerheden) in de meetwaarden van het RIVM (zie paragraaf 3.6). UNL gaf onzekerheden op in de totaal-alfa, totaal-bèta en totaal-gamma activiteitsconcentraties in afvalwater, maar niet in ventilatielucht.

4.2 Vergelijking van de resultaten en discussie

Het resultaat van de vergelijking (indien van toepassing) zoals beschreven in paragraaf 3.7 is in de tabellen van Bijlage A en B vermeld onder de kop ‘V’. De vergelijking van de resultaten van UNL met die van het RIVM is samengevat in Tabel 4 en Tabel 5. In deze tabellen is tevens tussen haakjes het volgens een normale statistische verdeling verwachte voorkomen aan categorieën A1-A2-B-C te zien. Zo is af te lezen of er significant meer of minder resultaten in een categorie vallen dan verwacht.

4.3 Afvalwater – 2023

De vergelijking van de totaal-alfa, totaal-bèta en gammaspectrometrie resultaten in afvalwater van 2023 is gegeven in Tabel 6. Met vier vergelijkingen van de categorie A1+A2 is het resultaat goed.

Tabel 6 Overeenkomst van meetresultaten totaal-alfa, totaal-bèta en gammastralers in afvalwater in 2023

Nr.	fabriek	totaal-alfa	totaal-bèta	γ -stralers*
1	SP4		A2	
2	SP5			
3	SP5	A1		
4	SP5			
5	SP5			
6	SP4			
7	CSB	A2	A1	
8	SP5			

* RIVM heeft in afvalwater slechts activiteitsconcentraties onder de detectiegrens gevonden. Hierdoor zijn er geen vergelijkingsparen gemaakt.

In de monsters 1-6 en 8 zijn de activiteits-concentraties in 2023 laag: $< 0,7 \text{ kBq}\cdot\text{m}^{-3}$ voor totaal-alfa, en $< 2,3 \text{ kBq}\cdot\text{m}^{-3}$ voor totaal-bèta. In monster 7 toonden UNL en RIVM beide een totaal-alfa activiteitsconcentratie aan van 13-16 $\text{kBq}\cdot\text{m}^{-3}$ en een totaal-bèta activiteitsconcentratie van 11-14 $\text{kBq}\cdot\text{m}^{-3}$; beide met een goede overeenstemming met de data van UNL.


Er is door RIVM voor de afvalwatermonsters van 2023 geen gamma-activiteit boven de detectiegrens waargenomen; UNL vond in monster 7 een geringe totaal-gamma activiteit van $4 \text{ kBq}\cdot\text{m}^{-3}$.

Correctie voor verval of ingroei van totaal-bèta activiteit tussen monstername en analyse

Het is gebruikelijk om totaal-alfa en totaal-bèta metingen in afvalwater niet te corrigeren voor ingroei of verval, omdat het niet duidelijk is welk nuclide het betreft. Bij afvalwater van UNL is deze voorkennis wel aanwezig. Het betreft de alfastralers ^{234}U , ^{235}U en ^{238}U , met zeer lange halveringstijden. De bètastralers ^{234}Th ($T_{1/2} = 24,1 \text{ d}$) en de dochter $^{234\text{m}}\text{Pa}$ ($T_{1/2} = 1,2 \text{ min}$) hebben echter een korte halveringstijd. Een correctie voor ingroei of verval is mogelijk en dat kan de overeenstemming tussen de meetwaarden van UNL en RIVM verbeteren. Dit is van toegevoegde waarde bij een contra expertise omdat er vaak een lange doorlooptijd zit tussen het moment van monstername en analyse door UNL, en de analyse door RIVM.

In natuurlijk uraan is de totaal-alfa activiteit gelijk aan de totaal-bèta activiteit. Een bèta-overschot vervalst in de tijd tussen monstername door UNL en meting door RIVM bij benadering naar de totaal-alfa waarde. Zie Figuur 2.


Figuur 2 Schematische weergave van een totaal-bèta overschot tijdens bemonstering en meting door UNL en later tijdens meting door RIVM

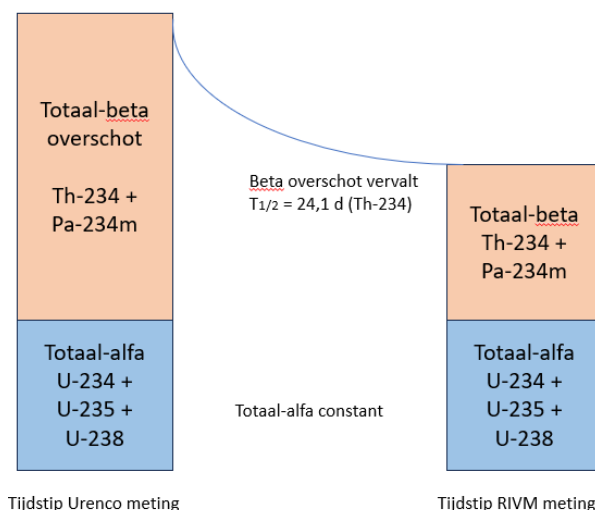

Indien de totaal-bèta activiteit groter is dan de totaal-alfa activiteit wordt het overschot (= totaal-bèta – totaal-alfa) gecorrigeerd voor verval met de halveringstijd van Th-234.

Anderzijds kan er bij een alfa-overschot sprake zijn van een ingroei van ^{234}Th naar de alfa-activiteit. Zie Figuur 3.

Figuur 3 Schematische weergave van een totaal-alfa overschot tijdens bemonstering en meting door UNL en later tijdens meting door RIVM: totaal-bèta groeit in naar de totaal-alfa activiteit.

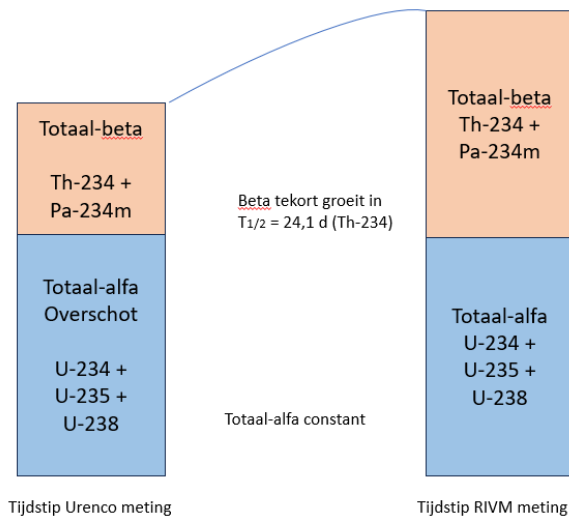

Indien de totaal-bèta activiteit kleiner is dan de totaal-alfa activiteit wordt het tekort (totaal-alfa – totaal-bèta) gecorrigeerd voor ingroei met de halveringstijd van Th-234.

Bij het uitvoeren van een ^{234}Th -vervalcorrectie is van de veronderstelling uitgegaan dat bij radiologisch evenwicht de totaal-alfa activiteit en totaal-bèta activiteit (ongeveer) gelijk aan elkaar zijn. Dit is echter bij afwijkingen van de natuurlijke verhouding van $^{235}\text{U} / ^{238}\text{U}$ niet het geval. Aangezien het onduidelijk is in welke mate de daadwerkelijke $^{235}\text{U} / ^{238}\text{U}$ verhouding in het monster afwijkt van de natuurlijke verhouding, kan niet altijd een 'perfecte' overeenkomst, een A1, verwacht worden.

De vergelijkingsresultaten in de totaal-bèta data van 2023 zijn in deze rapportageperiode goed (A1, A2). Er is in monster 2 sprake van een bèta-overschot; gecorrigeerd voor verval van ^{234}Th wordt de vergelijking een A1 in plaats van A2.

In monster 7 wordt een alfa overschot aangetroffen. Correctie voor ingroei van ^{234}Th naar de totaal-alfa activiteit doet de overeenkomst verbeteren van B naar A2; zie Tabel 7.

In de overige monsters is er geen sprake van een bèta of alfa overschot en is er geen reden om een correctie uit te voeren

Tabel 7 Aanpassing van de overeenkomst voor de totaal-bèta activiteitsconcentratie in monster 1 en 7 in 2023, na correctie voor verval of ingroei van ^{234}Th

Monster Nr. (2023)	Totaal- β meetdatum RIVM	V	Totaal- β UNL zonder ^{234}Th correctie	Totaal- β UNL met ^{234}Th correctie*	V
1	0,36 $\pm$ 0,09	A2	2,3 $\pm$ 1,2	0,4 $\pm$ 0,2	A1
7	14,6 $\pm$ 0,8	B	11,4 $\pm$ 1,1	13,0 $\pm$ 1,3	A2

* Hier is aangenomen dat UNL de meting uit heeft gevoerd op de dag van monstername. De correcties zijn uitgevoerd uitgaande van :

- het aantal dagen verschil tussen de monsterdatum van UNL en de meetdatum van het RIVM
- het verschil in de totaal-alfa en totaal-bèta activiteit, beide van UNL:
 - indien totaal-bèta > totaal-alfa dan wordt er gecorrigeerd voor verval van ^{234}Th naar de alfa activiteit.
 - indien totaal-bèta < totaal-alfa dan wordt er gecorrigeerd voor ingroei van ^{234}Th naar de alfa activiteit.
- de halfwaardetijd van ^{234}Th (24,1 dagen).

4.4 Ventilatielucht 2023

Tabel 8 bevat een samenvatting van de vergelijkingsresultaten van de totaal-alfa en totaal-bèta bepalingen in ventilatieluchtmonsters uit 2023. Er konden 12 vergelijkingen worden gemaakt: vijfmaal A1, een A2, een B en vijfmaal C.

Tabel 8 Overeenkomst van meetresultaten activiteitsconcentraties totaal-alfa en totaal-bèta in ventilatielucht in 2023

Periode 2023	SP4		SP5-1MA5		SP5-2MA5		CSB		RCC	
	alfa	bèta	alfa	bèta	alfa	bèta	alfa	bèta	alfa	bèta
12 feb - 19 feb		A1					B	C		
28 mei - 04 jun		A1						A1		
04 jun - 11 jun		C					A1	C		
23 jul - 30 jul							C	C		
15 okt - 22 okt							A2	A1		

* De meetresultaten bij de twee monsternamenpunten van SP5 en RCC hebben slechts detectiegrenzen opgeleverd. Hierdoor zijn er geen vergelijkingen uitgevoerd.

De totaal-alfa en totaal-bèta meetresultaten in ventilatielucht benaderen de meetverwachting matig. De vergelijking wordt bemoeilijkt door het feit dat de activiteitsconcentraties in de buurt liggen van de natuurlijke achtergrond, het van nature voorkomen van radon in binnen- en buitenlucht. Zie ook paragraaf 4.7, 'radon-exhalatie uit de betonnen verrijkingshallen'.

4.5 Afvalwater 2024

De vergelijking van de totaal-alfa, totaal-bèta en gammaspectrometrie resultaten in afvalwater van 2024 is gegeven in Tabel 9. Met vier vergelijkingen, allen in de categorie A1 of A2, is het resultaat goed.

Tabel 9 Overeenkomst van meetresultaten totaal-alfa, totaal-bèta en gammastralers in afvalwater in 2024

Nr.	Fabriek	totaal- α	totaal- β	γ -stralers*
1	SP5			
2	SP5	A2	A1	
3	RCC	A2		
4	RCC			
5	SP5			
6	SP4	A2		
7	SP5			
8	SP5			

* RIVM heeft in afvalwater slechts gamma-activiteitsconcentraties onder de detectiegrens gevonden. Hierdoor zijn er geen vergelijkingsparen gemaakt.

In de monsters 1 en 3-8 zijn de activiteits-concentraties in 2024 laag: onder de $1,0 \text{ kBq}\cdot\text{m}^{-3}$ voor totaal-alfa en totaal-bèta. In monster 2 toonden UNL en RIVM beide een totaal-alfa activiteitsconcentratie aan van $4,1\text{-}4,9 \text{ kBq}\cdot\text{m}^{-3}$. De totaal-bèta activiteitsconcentratie bedroeg $5,6\text{-}5,9 \text{ kBq}\cdot\text{m}^{-3}$. In beide gevallen een goede overeenstemming met de meetdata van UNL.

Er is door RIVM in 2024 geen gamma-activiteit boven de detectiegrens waargenomen; UNL vond in monster 2 een geringe gamma activiteit van ^{234}Th ; $3,5 \pm 1,7 \text{ kBq}\cdot\text{m}^{-3}$.

Correctie voor verval of ingroei van totaal-bèta activiteit tussen monsternamen en analyse (zie toelichting in par. 4.3).

In monster 2 wordt een licht bèta overschot door UNL aangetroffen; $5,9 \text{ kBq}\cdot\text{m}^{-3}$ totaal-bèta tegenover $4,1 \text{ kBq}\cdot\text{m}^{-3}$ totaal-alfa. Correctie voor verval van ^{234}Th naar de totaal-alfa activiteit doet de overeenkomst verminderen van A1 naar A2; zie Tabel 10. In de overige monsters is er geen sprake van een bèta of alfa overschot en is er geen reden om een correctie uit te voeren.

Tabel 10 Aanpassing van de overeenkomst voor de totaal-bèta activiteitsconcentratie in monster 2 (in 2024) na correctie voor verval of ingroei van ^{234}Th

Monster Nr. (2024)	Totaal- β meetdatum RIVM	V	Totaal- β UNL zonder ^{234}Th correctie	Totaal- β UNL met ^{234}Th correctie	V
2	$5,6 \pm 0,3$	A1	$5,9 \pm 1,0$	$4,2 \pm 0,7$	A2

* Hier is aangenomen dat UNL de meting uit heeft gevoerd op de dag van monsternamen. De correcties zijn uitgevoerd uitgaande van :

- het aantal dagen verschil tussen de monsterdatum van UNL en de meetdatum van het RIVM
- het verschil in de totaal-alfa en totaal-bèta activiteit, beide van UNL:
 - indien totaal-bèta > totaal-alfa dan wordt er gecorrigeerd voor verval van ^{234}Th naar de alfa activiteit.
 - indien totaal-bèta < totaal-alfa dan wordt er gecorrigeerd voor ingroei van ^{234}Th naar de alfa activiteit.
- de halfwaardetijd van ^{234}Th (24,1 dagen).

4.6 Ventilatielucht 2024

Tabel 11 bevat een samenvatting van de vergelijkingsresultaten van de totaal-alfa en totaal-bèta bepalingen in ventilatieluchtmonsters uit 2024. Er konden 9 vergelijkingen worden gemaakt: driemaal A1, driemaal A2 en driemaal C.

Tabel 11 Overeenkomst van meetresultaten activiteitsconcentraties totaal-alfa en totaal-bèta in ventilatielucht in 2023

Periode 2024	SP4		SP5-1MA5		SP5-2MA5		CSB		RCC	
	alfa	bèta	alfa	bèta	alfa	bèta	alfa	bèta	alfa	bèta
11 feb - 18 feb								A1		
26 mei - 02 jun		A1						A2		
02 jun - 09 jun		A2						A2		
04 aug - 11 aug		A1						C		
03 nov - 10 nov		C						C		

* De meetresultaten bij de twee monsternamepunten van SP5 en bij RCC hebben slechts detectiegrenzen opgeleverd. Hierdoor zijn er geen vergelijkingen uitgevoerd.

De totaal-alfa en totaal-bèta meetresultaten in ventilatielucht benaderen de statistische verwachting redelijk. De vergelijking wordt bemoeilijkt door het feit dat de activiteitsconcentraties in de buurt liggen van de natuurlijke achtergrond, het van nature voorkomen van radon in binnen- en buitenlucht. Zie ook paragraaf 4.7, de 'radon-exhalatie uit de betonnen verrijkingshallen'.

4.7 Radonexhalatie uit de betonnen verrijkingshallen

RIVM heeft in een eerdere rapportage aannemelijk gemaakt dat de totaal-alfa en totaal-bèta activiteit op de ventilatieluchtfilters van CSB hoogstwaarschijnlijk te wijten is aan radondochters afkomstig van radon in de buitenlucht [14]. Radon emaneert echter ook uit de betonnen oppervlakken van de verrijkingshallen. Het is mogelijk om een schatting te maken van de som van radon uit de buitenlucht + uit beton geëmaneerd radon. Dit radonniveau, en niet de detectiegrens van de apparatuur, beïnvloedt in grote mate de bepaalbaarheidsgrens voor totaal-alfa en totaal-bèta afkomstig van uranium. Deze zogenaamde radonruis kan omgerekend worden naar een realistische ondergrens voor de bepaling van totaal-alfa en totaal-bèta op de luchtfilters.

Toelichting

Radon vervalt via een aantal kortlevende dochternucliden naar ^{210}Pb (en dochter ^{210}Bi). Dit nuclide is een bèta/gammastraler en vervalt naar de (relatief langzaam) ingroeierende alfastraler ^{210}Po . Dit heeft als logisch gevolg dat de aanwezigheid van het edelgas radon in ventilatielucht uiteindelijk leidt op het filter tot een lage totaal-alfa en totaal-bèta activiteit die niet het gevolg is van een uraniumlozing. Kenmerk van een ^{210}Pb / ^{210}Po depositie op een filter is dat de totaal-alfa activiteit altijd een factor 3-7 lager is dan de totaal-bèta activiteit. Dit in tegenstelling tot natuurlijk uranium waarbij de activiteit aan totaal-alfa en totaal-bèta vrijwel gelijk is aan elkaar; en verrijkt uranium waarbij de totaal-alfa activiteit hoger is dan de activiteit van totaal-bèta.

Schatting van totaal-bèta als gevolg van radon in ventilatielucht

Met de aannames die gemaakt zijn in het eerdergenoemde rapport [14] is voor SP4, SP5 en CSB een schatting gemaakt van de radonexhalatie uit betonnen oppervlakken. Dit leidt tot de productie van de bètastralers $^{210}\text{Pb} + ^{210}\text{Bi}$. De daaruit volgende ^{210}Po -alfa activiteit is na 30 dagen voor 14% ingegroeid; dit houdt in dat de tijd tussen meting door UNL en het RIVM van groot belang is voor de vergelijking van totaal-alfa. Deze tijd kan in praktijk variëren tussen 10 en soms meer dan 80 dagen. Hierdoor heeft het vergelijken van totaal-alfa data van UNL en RIVM weinig zin indien de ingroei van ^{210}Po van dezelfde orde van grootte is als de 'normale' totaal-alfa activiteit. In Tabel 12 worden de geschatte totaal-bèta waarden vergeleken met daadwerkelijk aangetroffen totaal-bèta waarden in 2023; de totaal-alfa data zijn om de bovengenoemde reden buiten de tabel gehouden.

Tabel 12 Totaal-bèta berekend als gevolg van radon, en gemeten waarden ($\text{mBq}\cdot\text{m}^{-3}$); minimum en maximum activiteitsconcentraties in 5 filters uit 2023.

Data 2023 Fabriek	Totaal-bèta gemeten (RIVM)	Totaal-bèta gemeten (UNL)	Totaal-bèta (berekend uit radon; [E])]	Ondergrens (berekend uit radon)
SP4	0,06 – 0,14	0,07 – 0,4	0,09	0,18
SP5	0,17 - 0,29	< 0,3	0,016	0,03
CSB	0,05 – 0,11	0,07 - 0,4	0,01	0,02 (0,06)
RCC	0,02 - 0,04	< 0,04		
Totaal-bèta (UNL)		(min-max; $\text{mBq}\cdot\text{m}^{-3}$)		
CSB-buiten 2023		0,10 - 0,44		
CSB-buiten 2024		0,12 – 0,57		
Buitenlucht–Bilthoven*		0,14 – 1,0		

* De waarde voor totaal-bèta in luchtstof in 2023 bemonsterd te Bilthoven met de High Volume Sampler. Per week wordt circa 125.000 m^3 aangezogen en geanalyseerd.

Vaststelling van ondergrens voor totaal-bèta

Met de data uit Tabel 12 en een ruime marge van een factor 2 is een ondergrens voor totaal-bèta eenvoudig berekend in de rechterkolom. Onder deze grens heeft het uitvoeren van contra expertise geen nut omdat er feitelijk radondochters met elkaar worden vergeleken. Voor CSB valt de berekende ondergrens van 0,02 $\text{mBq}\cdot\text{m}^{-3}$ vrijwel op de detectiegrens. Het is echter niet doenlijk om elke waarde boven de detectiegrens als een 'echte' waarde voor totaal-bèta te beschouwen. De spreiding is daarvoor te groot. Vandaar dat er is gekozen voor een totaal-bèta ondergrens voor CSB van minimaal een factor 3 boven de detectiegrens: 0,06 $\text{mBq}\cdot\text{m}^{-3}$.

Vergelijking met buitenlucht

Onder in Tabel 12 staan de totaal-bèta data van metingen in bemonsterde buitenlucht. Enerzijds op monsterlocatie CSB-buiten in 2023 en 2024, en anderzijds met de High Volume Sampler in Bilthoven in 2023. Het is duidelijk dat de spreiding in de totaal-bèta concentraties in buitenlucht groot is. En dat de ondergrens voor totaal-bèta, berekend

uit radon-exhalatie, bijna overeenkomt met de minimumwaarde voor totaal-bèta in buitenlucht.

Onzekerheden

De onzekerheden in de berekende totaal-bèta waarden zijn groot. Dit komt o.a. door onzekerheden in de schattingen van het betonoppervlak, in de radon exhalatie uit beton en schattingen van de flow door het betreffende gebouw. Ook de natuurlijke variatie van radon in de buitenlucht speelt een rol. Alle lucht van RCC en SP5 (1MA5 en 2MA5) wordt gefilterd voordat deze wordt geloosd en bemonsterd. Hierdoor is er voor RCC en SP5 geen invloed van radon in de buitenlucht en bij CSB en SP4 wel. In SP4 en CSB wordt een groot deel ongefilterd geloosd waardoor radondochters niet zijn weggefilterd.

Een totale onzekerheid in de totaal-bèta activiteit laat zich lastig kwantificeren, maar het is aannemelijk dat een bandbreedte van een factor 2 ongeveer het minimum is. Dit is namelijk de spreiding in de radonexhalatie in betonnen oppervlakken. Deze spreiding kan volgens het Basisdocument Radon [15] variëren tussen 0,5 en 1 $\text{mBq}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{s}^{-1}$.

Alfa/bèta verhouding als criterium voor niet-natuurlijke activiteit

Op basis van de hierboven beschreven totaal-bèta activiteit kan alleen aannemelijk gemaakt worden dat een deel van de ventilatieluchtlozing afkomstig is van natuurlijke activiteit. Er zijn echter gevallen denkbaar dat er sprake is van een (geringe) uranium vrijzetting. Hieronder wordt dit nader toegelicht.

- Indien radondochters op de ventilatiefilters terechtkomen dan is radiochemisch evenwicht voor de bèta-stralers ^{210}Pb en ^{210}Bi betrekkelijk snel bereikt, maar voor ^{210}Po is er pas na 138 dagen een ingroei van 50% bereikt. De natuurlijke totaal-bèta activiteit zal doorgaans factoren (3-7) groter zijn dan de totaal-alfa activiteit.
- Een vrijzetting van uranium zou tot een verhoging van de totaal-alfa en totaal-bèta activiteit leiden die direct na de bemonstering ongeveer van vergelijkbare grootte is. De verhouding is afhankelijk van de verrijkingsgraad. Bij verrijkt uranium is de totaal-alfa activiteit groter dan de totaal-bèta activiteit. En bij verarmd uraan juist andersom.
- De absolute totaal-bèta activiteitsconcentratie is dus niet zozeer een reden om een uranium-vrijzetting te vermoeden, maar de *verhouding alfa/bèta* is dat wel. Indien totaal-alfa én totaal-bèta beide dus verhoogd zijn en ongeveer gelijk aan elkaar bestaat er een vermoeden van een uranium-vrijzetting.

Toepassing op ventilatieluchtdata 2023 en 2024

In 2023 en 2024 is er bij CSB in enkele monsters een verhoging aangetroffen van de totaal-bèta activiteit boven de ondergrens van 0,06 $\text{mBq}\cdot\text{m}^{-3}$, en bij SP4 is evenzo enkele malen boven de 0,18 $\text{mBq}\cdot\text{m}^{-3}$. Zie de Tabellen A3 en B3. In al deze monsters is de totaal-alfa activiteitsconcentratie ruwweg een factor 10 lager dan de totaal-bèta activiteitsconcentratie. Er dus geen sprake van een gelijktijdige totaal-alfa en totaal-bèta verhoging. Het betreft hoogstwaarschijnlijk radondochters.

Tabel 13 Overzicht van totaal-bèta activiteitsconcentraties gemeten door RIVM op ventilatieluchtfilters in 2023 en 2024; de waarden zijn min-max waarden voor totaal-bèta op de 5 filters ($\text{mBq}\cdot\text{m}^{-3}$)

	Ondergrens	2023	2024	Opmerkingen
SP4	0,18	0,05-0,14	0,09-0,16	Niet boven de ondergrens.
SP5	0,03*	0,17-0,30	0,15-0,28	Gemeten waarden zijn lager dan buiten.
CSB	0,02 (0,06)	0,05-0,11	0,04-2,4	Idem als SP5.
RCC#	nvt	0,02-0,05	0,03-0,09	

* Bij SP5 is de berekende ondergrens lager dan detectiegrens.

Van RCC zijn de dimensies en het ventilatievoud niet bekend bij RIVM, zodat er geen ondergrens berekend kan worden.

Bij SP5 (1MA5 en 2MA5) zijn de aangetroffen activiteitsconcentraties in 2023 en 2024 zeer laag. UNL rapporteert slechts detectiegrenzen voor totaal-alfa en totaal-bèta. RIVM vindt in een enkel geval een zeer licht verhoogde totaal-alfa activiteit in de orde van 10 % van de totaal-bèta activiteit. Ook dit betreft hoogstwaarschijnlijk radondochters.

Bij RCC zijn er slechts detectiegrenzen gerapporteerd door UNL. In vier monsters treft RIVM een zeer lage activiteitsconcentratie aan totaal-bèta aan, vrijwel samenvallend met de detectiegrens van UNL.

4.8 Oordeel over de resultaten 2023 en 2024

De trend van deze vergelijking in 2023 en 2024 is dat de door RIVM en UNL gemeten activiteitsconcentraties in afvalwater in zeven van de acht monsters laag zijn ($< 1 \text{ kBq}\cdot\text{m}^{-3}$ voor totaal-alfa en $< 2,3 \text{ kBq}\cdot\text{m}^{-3}$ voor totaal-bèta). In 1 monster in 2023 was de activiteitsconcentratie licht verhoogd: $16 \text{ kBq}\cdot\text{m}^{-3}$ voor totaal-alfa en voor totaal-bèta $14 \text{ kBq}\cdot\text{m}^{-3}$. In 2024 was er eveneens een watermonster met een zeer lichte verhoogde activiteitsconcentratie: 4 - 5 $\text{kBq}\cdot\text{m}^{-3}$ voor totaal-alfa en voor totaal-bèta 5,5 - 6 $\text{kBq}\cdot\text{m}^{-3}$.

De overeenstemming tussen de RIVM en UNL resultaten was goed; zie Tabel 14.

Tabel 14 Overzicht van contra expertise resultaten in 2023 en 2024

	2023	2024
Afvalwater		
- Totaal-alfa	Goed	Goed
- Totaal-bèta	Goed	Goed
- Gamma	$< \text{MDA}$	$< \text{MDA}$
Ventilatielucht		
- Totaal-alfa	Redelijk (radon ruis)	Redelijk (radon ruis)
- Totaal-bèta	Redelijk (radon ruis)	Redelijk (radon ruis)
- Gamma	Nvt*	Nvt*

* De ventilatieluchtfilters worden alleen gammaspectrometrisch geanalyseerd indien een ondergrens aan totaal-alfa of totaal-bèta activiteit is overschreden. Dit is in 2023 niet voorgekomen.

De radon exhalatie uit de betonnen oppervlakken van de fabriekshallen veroorzaken een aanzienlijk deel van de totaal-bèta-activiteit op de

ventilatieluchtfilters. Naast een eventuele verhoging van de totaal-bèta activiteit wordt ook de verhouding totaal-bèta / totaal-alfa meegenomen in de beoordeling van de ventilatieluchresultaten. Na toepassing van beide criteria is het niet aannemelijk dat er in de 5 vergeleken monsterperiodes van een week in 2023 en 2024 een uranium-vrijzetting plaatsgevonden heeft.

De aanwezigheid van natuurlijke radon dochters kan het verschil tussen de door UNL en RIVM vastgestelde activiteit verklaren.

5 Bijlage A Vergelijking met meetresultaten UNL in 2023

Afvalwater 2023

Tabel A1 Vergelijking activiteitsconcentraties totaal-alfa, totaal-bèta en gammastralers in afvalwater (kBq·m⁻³) in 2023

Nr.	Datum	Fabriek	Totaal-α			Totaal-β		
			RIVM	V	UNL	RIVM	V	UNL
1	12 jan	SP4	0,31 ± 0,06		< 0,3	0,36 ± 0,09	A2	2,3 ± 1,2
2	07 feb	SP5	< 0,12		< 0,4	< 0,3		< 1,0
3	14 jun	SP5	0,63 ± 0,07	A1	0,7 ± 0,3	0,55 ± 0,08		< 1,5
4	23 jun	SP5	< 0,11		< 0,4	< 0,3		< 1,1
5	14 aug	SP5	0,14 ± 0,03		< 0,3	< 0,3		< 1,1
6	12 aug	SP4	0,34 ± 0,05		< 0,4	0,54 ± 0,09		< 1,1
7	18 okt	CSB	16,1 ± 1,6	A2	13,1 ± 1,2	14,6 ± 0,8	B	11,4 ± 1,1
8	25 okt	SP5	< 0,14		< 0,4	< 0,4		< 0,9

N.B. de detectiegrens gegeven door RIVM betreft ²³⁴Th. De RIVM-detectiegrens voor de volgende gammastralers is: 0,7 kBq·m⁻³ voor ⁶⁰Co en ¹³⁷Cs, en 3-5 kBq·m⁻³ voor ²³⁵U.

Tabel A1 (Vervolg)

Nr.	Datum	Fabriek	γ-stralers	
			RIVM*	UNL [#]
1	12 jan	SP4	< 4	< 1,5
2	07 feb	SP5	< 2	< 2,0
3	14 jun	SP5	< 2	< 1,6
4	23 jun	SP5	< 2	< 1,6
5	14 aug	SP5	< 5	< 1,8
6	12 aug	SP4	< 2	< 1,6
7	18 okt	CSB	< 3	4,0 ± 1,6
8	25 okt	SP5	< 5	< 1,7

* De detectiegrenzen zijn van ²³⁴Th.

UNL rapporteert de gamma van ²³⁴Th

Tabel A2 Nuclidenbibliotheek gebruikt voor bepaling van gammastralers

⁷ Be	⁶⁵ Zn*	¹⁰³ Ru*	¹²⁵ I	¹³⁶ Cs	¹⁸⁸ W	²¹⁹ Rn
²² Na	⁶⁷ Ga	¹⁰⁶ Ru*	¹²⁵ Sb†	¹³⁷ Cs*	¹⁹¹ Os	²²³ Ra
²⁴ Na	⁷⁵ Se	¹⁰⁹ Cd	¹²⁹ I	¹³⁹ Ce	²⁰² Tl	²²⁶ Ra
⁴⁰ K	⁸² Br	^{110m} Ag*	¹²⁹ Te	¹⁴⁰ Ba*	²⁰³ Hg	²²⁷ Th
⁵¹ Cr*	⁸³ Rb	¹¹¹ In	^{129m} Te	¹⁴⁰ La*	²⁰³ Pb	²²⁸ Ac
⁵⁴ Mn*	⁸⁵ Sr	¹¹³ Sn	¹³¹ I*	¹⁴¹ Ce*	²⁰⁸ Tl	²³⁰ Th
⁵⁶ Co	⁸⁸ Y	¹¹⁵ Cd	¹³² I	¹⁴⁴ Ce*	²¹⁰ Pb	²³¹ Pa
⁵⁷ Co*	⁹⁵ Nb*	^{115m} Cd	¹³² Te	¹⁵² Eu	²¹² Bi	^{234m} Pa
⁵⁸ Co*	^{95m} Tc	¹²¹ Te	¹³³ I	¹⁸¹ W	²¹² Pb	²³⁴ Th
⁵⁹ Fe†	⁹⁵ Zr*	^{123m} Te†	¹³³ Xe	¹⁸⁵ W	²¹⁴ Bi	²³⁵ U
⁶⁰ Co*	⁹⁹ Mo	¹²⁴ Sb*	¹³⁴ Cs*	¹⁸⁶ Re	²¹⁴ Pb	²⁴¹ Am

* Volgens KTA 1503.1 en KTA 1504 te onderzoeken nucliden [9, 10]

† Volgens KTA 1504 te onderzoeken nucliden [10].

Overige nucliden zijn opgenomen in de generieke gammabibliotheek die ook voor afvalwater van UNL, COVRA, NRG en RID wordt toegepast.

Ventilatielucht 2023

Tabel A3 Meetresultaten activiteitsconcentraties van totaal-alfa in ventilatielucht (mBq·m⁻³)

Totaal-alfa Periode 2023	SP4		SP5-1MA5		SP5-2MA5	
	RIVM	V UNL	RIVM	UNL	RIVM	UNL
12 feb - 19 feb	0,031 ± 0,006	< 0,03	0,033 ± 0,012	< 0,07	< 0,03	< 0,07
28 mei - 04 jun	0,015 ± 0,002	< 0,012	< 0,03	< 0,08	< 0,03	< 0,07
04 jun - 11 jun	< 0,008	0,05	< 0,03	< 0,08	< 0,03	< 0,08
23 jul - 30 jul	0,016 ± 0,003	< 0,016	< 0,03	< 0,07	< 0,03	< 0,07
15 okt - 22 okt	0,023 ± 0,004	< 0,02	< 0,03	< 0,08	< 0,03	< 0,08

Tabel A3 (vervolg)

Totaal-alfa Periode 2023	CSB			RCC	
	RIVM	V UNL		RIVM	UNL
12 feb - 19 feb	0,023 ± 0,002	B	0,013	< 0,008	< 0,013
28 mei - 04 jun	0,0111 ± 0,0015		< 0,007	0,009 ± 0,002	< 0,009
04 jun - 11 jun	0,0147 ± 0,0018	A1	0,015	< 0,005	< 0,011
23 jul - 30 jul	0,0108 ± 0,0015	C	0,018	< 0,006	< 0,010
15 okt - 22 okt	0,0134 ± 0,0017	A2	0,009	< 0,005	< 0,011

* Indien de NI geen opgave doet van de onzekerheid in het analysesresultaat, wordt de vergelijking uitgevoerd met de RIVM onzekerheid.

Tabel A4 Vergelijking activiteitsconcentraties totaal-bèta in ventilatielucht
(mBq·m⁻³)

Totaal-bèta Periode 2023	SP4			SP5-1MA5		SP5-2MA5	
	RIVM	V	UNL	RIVM	UNL	RIVM	UNL
12 feb - 19 feb	0,142 ± 0,013	A1	0,16	0,28 ± 0,04	< 0,3	0,27 ± 0,03	< 0,3
28 mei - 04 jun	0,129 ± 0,008	A1	0,14	0,23 ± 0,02	< 0,3	0,23 ± 0,03	< 0,3
04 jun - 11 jun	0,056 ± 0,006	C	0,4	0,30 ± 0,03	< 0,3	0,20 ± 0,03	< 0,3
23 jul - 30 jul	0,096 ± 0,008		< 0,07	0,20 ± 0,02	< 0,3	0,17 ± 0,02	< 0,3
15 okt - 22 okt	0,132 ± 0,011		< 0,08	0,17 ± 0,02	< 0,3	0,21 ± 0,03	< 0,3

Tabel A4 (vervolg)

Totaal-bèta Periode 2023	CSB			RCC		
	RIVM	V	UNL	RIVM	V	UNL
12 feb - 19 feb	0,109 ± 0,006	C	0,16	0,047 ± 0,006		< 0,06
28 mei - 04 jun	0,064 ± 0,004	A1	0,07	0,021 ± 0,004		< 0,04
04 jun - 11 jun	0,097 ± 0,006	C	0,15	0,031 ± 0,004		< 0,04
23 jul - 30 jul	0,050 ± 0,004	C	0,4	0,031 ± 0,005		< 0,04
15 okt - 22 okt	0,094 ± 0,005	A1	0,10	0,034 ± 0,004		< 0,04

* Indien de NI geen opgave doet van de onzekerheid in het analyseresultaat, wordt de vergelijking uitgevoerd met de RIVM onzekerheid.

Tabel A5 Meetresultaten van UNL: activiteitsconcentraties van totaal-alfa en totaal-bèta in CSB-Buitenlucht in 2023 (mBq·m⁻³)

Periode 2023	UNL: CSB-Buiten	
	Totaal-alfa	Totaal-bèta
12 feb - 19 feb	0,036	0,37
28 mei - 04 jun	0,019	0,14
04 jun - 11 jun	0,039	0,37
23 jul - 30 jul	0,022	0,10
15 okt - 22 okt	0,042	0,44

6 Bijlage B Vergelijking met meetresultaten UNL in 2024

Afvalwater 2024*Tabel B1 Vergelijking activiteitsconcentraties totaal-alfa, totaal-bèta en gammastralers in afvalwater (kBq·m⁻³) in 2024*

Nr.	Datum	Fabriek	Totaal- α			Totaal- β		
			RIVM	V	UNL	RIVM	V	UNL
1	03 mrt	SP5	< 0,15		< 0,4	0,39 ± 0,12		< 1,2
2	05 apr	SP5	4,9 ± 0,5	A2	4,1 ± 0,4	5,6 ± 0,3	A1	5,9 ± 1,0
3	09 apr	RCC	0,49 ± 0,08	A2	0,31 ± 0,13	< 0,3		< 1,1
4	14 jun	RCC	0,24 ± 0,06		< 0,3	< 0,3		< 1,1
5	25 jun	SP5	0,36 ± 0,08		< 0,2	< 0,3		< 1,1
6	20 aug	SP4	0,13 ± 0,05	A2	0,32 ± 0,12	0,39 ± 0,11		< 1,0
7	30 aug	SP5	0,47 ± 0,08		< 0,5	0,62 ± 0,10		< 0,9
8	25 nov	SP5	< 0,15		< 0,3	< 0,4		< 0,9

N.b. de detectiegrens gegeven door RIVM betreft ²³⁴Th.

De RIVM-detectiegrens voor de volgende gammastralers is :
0,7 kBq·m⁻³ voor ⁶⁰Co en ¹³⁷Cs , en 3-5 kBq·m⁻³ voor ²³⁵U.

Tabel B1 (Vervolg)

Nr.	Datum	Fabriek	γ -stralers	
			RIVM*	UNL [#]
1	03 mrt	SP5	< 5	< 1,7
2	05 apr	SP5	< 5	3,5 ± 1,7
3	09 apr	RCC	< 5	< 1,6
4	14 jun	RCC	< 4	< 2,4
5	25 jun	SP5	< 5	< 1,1
6	20 aug	SP4	< 4	< 1,7
7	30 aug	SP5	< 5	< 1,7
8	25 nov	SP5	< 5	< 2,2

* De detectiegrenzen zijn van ²³⁴Th.

[#] UNL rapporteert de gamma-activiteit van ²³⁴Th.

Ventilatielucht 2024*Tabel B2 Meetresultaten activiteitsconcentraties van totaal-alfa in ventilatielucht (mBq·m⁻³)*

Totaal-alfa Periode 2024	SP4		SP5-1MA5		SP5-2MA5	
	RIVM	UNL	RIVM	UNL	RIVM	UNL
11 feb - 18 feb	0,019 ± 0,004	< 0,02	< 0,03	< 0,07	< 0,03	< 0,07
26 mei - 02 jun	0,024 ± 0,003	< 0,016	< 0,03	< 0,09	0,054 ± 0,014	< 0,09
02 jun - 09 jun	0,020 ± 0,003	< 0,017	< 0,03	< 0,09	0,041 ± 0,010	< 0,09
04 aug - 11 aug	0,023 ± 0,003	< 0,15	< 0,03	< 0,09	< 0,03	< 0,09
03 nov - 10 nov	< 0,015	< 0,03	0,034 ± 0,013	< 0,08	0,055 ± 0,014	< 0,07

Tabel B2 (vervolg)

Totaal-alfa Periode 2024	CSB		RCC	
	RIVM	UNL	RIVM	UNL
11 feb - 18 feb	0,0138 ± 0,0018	< 0,007	< 0,005	< 0,009
26 mei - 02 jun	0,0099 ± 0,0015	< 0,008	< 0,005	< 0,011
02 jun - 09 jun	0,0089 ± 0,0014	< 0,008	< 0,006	< 0,011
04 aug - 11 aug	0,0095 ± 0,0014	< 0,009	0,011 ± 0,002	< 0,012
03 nov - 10 nov	0,0161 ± 0,0019	< 0,07*	0,011 ± 0,002	< 0,010

* In deze week was het bemonsterde volume op het filter ongeveer 1/10 van een normaal volume. Vandaar de hogere detectiegrens.

Tabel B3 Vergelijking activiteitsconcentraties totaal-bèta in ventilatielucht (mBq·m⁻³)

Totaal-bèta Periode 2024	SP4			SP5-1MA5		SP5-2MA5	
	RIVM	V	UNL	RIVM	UNL	RIVM	UNL
11 feb - 18 feb	0,092 ± 0,011		< 0,10	0,17 ± 0,02	< 0,3	0,15 ± 0,03	< 0,3
26 mei - 02 jun	0,136 ± 0,009	A1	0,14	0,18 ± 0,04	< 0,3	0,24 ± 0,03	< 0,3
02 jun - 09 jun	0,155 ± 0,010	A2	0,13	0,16 ± 0,04	< 0,3	0,18 ± 0,04	< 0,3
04 aug - 11 aug	0,124 ± 0,008	A1	0,13	0,18 ± 0,03	< 0,3	0,23 ± 0,03	< 0,3
03 nov - 10 nov	0,130 ± 0,014	C	0,3	0,28 ± 0,03	< 0,3	0,15 ± 0,03	< 0,3

Tabel B3 (vervolg)

Totaal-bèta Periode 2024	CSB			RCC		
	RIVM	V	UNL[#]	RIVM	V	UNL
11 feb - 18 feb	0,056 ± 0,004	A1	0,06	0,043 ± 0,005		< 0,04
26 mei - 02 jun	0,072 ± 0,005	A2	0,08	0,036 ± 0,005		< 0,04
02 jun - 09 jun	0,070 ± 0,005	A2	0,06	0,033 ± 0,005		< 0,04
04 aug - 11 aug	0,066 ± 0,005	C	0,04	0,025 ± 0,005		< 0,04
03 nov - 10 nov	0,171 ± 0,009	C	2,4*	0,090 ± 0,007		< 0,04

Indien de NI geen opgave doet van de onzekerheid in het analyseresultaat, wordt de vergelijking uitgevoerd met de RIVM onzekerheid.

* In deze week was het bemonsterde volume op het filter ongeveer 1/10 van een normaal volume. Vandaar de hogere detectiegrens.

Tabel B4 Meetresultaten van UNL activiteitsconcentraties van totaal-alfa en totaal-bèta in CSB-Buitenlucht in 2024 (mBq·m⁻³)

Periode 2024	UNL: CSB-Buiten	
	Totaal-alfa	Totaal-bèta
11 feb - 18 feb	0,014	0,12
26 mei - 02 jun	0,026	0,26
02 jun - 09 jun	0,025	0,17
04 aug - 11 aug	< 0,01	0,19
03 nov - 10 nov	0,035	0,57

7 Bijlage C UNL analyse van afvalwatermonsters voor lozing op het riool

Ontvangen oktober 2023; revisie 04.

Nummer: I 1.2.5-070
Revisie: 04
Datum: 07-08-2023
Pagina: 1 van 12

UNL
Instructie



Indien geprint, controleer of dit de laatste versie is

ANALYSE VAN AFVALWATER VOOR LOZING OP HET RIOOL

1 DOEL

Het vastleggen van alle handelingen die nodig zijn om afvalwatermonsters van afvalwatertanks, met als doel lozing op het riool, te analyseren op de pH en op aanwezigheid van radionucliden.

2 SCOPE

Deze instructie geldt voor monsters afkomstig van afvalwatertanks waarvan het water zal worden geloosd op het riool.

Deze instructie geldt niet voor afvalwatertanks van het SIB.

De 1 liter afvalwatergeometrie, gebruikt voor de gamma-analyse, is tevens het monster dat ter beschikking wordt gesteld aan het RIVM voor contra expertise analyse.

3 DEFINITIES

QC Quality Control
LIMS Laboratorium Informatie Management Systeem
SIB Stable Isotopes Building
FWHM Full Width at Half Maximum
RIVM Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu

4 VERANTWOORDELIJKHEDEN

Het is de taak van de uitvoerende de in deze instructie aangegeven werkzaamheden te volgen. De leidinggevende controleert dat de werkzaamheden in overeenstemming met deze instructie worden uitgevoerd en beoordeelt de resultaten. In geval van twijfel bij handelingen volgens deze instructie moet de uitvoerende contact opnemen met de leidinggevende.

5 WERKWIJZE

Een gecertificeerde uraniumstandaardoplossing is noodzakelijk voor de analyse van de volumieke alfa- en bèta-activiteit. Voor de controle van de pH meter wordt gebruik gemaakt van gecertificeerde buffers. De aangeboden monsters dienen als zijnde radioactief te worden behandeld. De germaniumdetectoren dienen te beschikken over een geldige kalibratiecontrole- en achtergrondmeting voordat de analyse wordt uitgevoerd. Een gasdoorstroom detector in combinatie met een platenwisselaar wordt gebruikt voor het bepalen van de volumieke alfa- en bèta-activiteit. De aan te leveren hoeveelheid monster is 2 liter.

Nummer: I 1.2.5-070
 Revisie: 04
 Datum: 07-08-2023
 Pagina: 3 van 12

UNL Instructie



Indien geprint, controleer of dit de laatste versie is

5.1 Benodigheden

Materialen en apparatuur	Chemicaliën	Standaarden
Gasdoorstroom detector Platenwisselaar Germanium detector pH-meter Stoof 100 µl Finn timer 250 ml en 1 l Kunststof monsterpot met deksel RVS afvalwaterplaten Huishoudfolie Scotch Brite 100 ml Kunststof bekken 100 ml Maatcilinder Kunststof roerstaafje	25% Salpeterzuur (HNO_3) 33% Natronloog (NaOH) Iso-propanol Vloeibare zeep Vloeibaar schuurmiddel	Buffer pH 4 Buffer pH 7 Buffer pH 10 Gecertificeerde uraniumstandaard (circa 200 Bq/ml ^{238}U) QC plaat voor QC plaat na

Beide QC platen worden door CS-EA beschikbaar gesteld.

5.2 Oplossingen

0,33% NaOH oplossing

- Vul een maatkolf van 100 ml voor de helft met Milli-Q water.
- Voeg met een finnpipet 1 ml 33% NaOH toe en vul aan met Milli-Q water tot 100 ml.

3,3% NaOH oplossing

- Vul een maatkolf van 100 ml voor de helft met Milli-Q water.
- Voeg met een finnpipet 10 ml 33% NaOH toe en vul aan met Milli-Q water tot 100 ml.

0,25% HNO_3 oplossing

- Vul een maatkolf van 100 ml voor de helft met Milli-Q water.
- Voeg met een finnpipet 1 ml 25% HNO_3 toe en vul aan met Milli-Q water tot 100 ml.

2,5% HNO_3 oplossing

- Vul een maatkolf van 100 ml voor de helft met Milli-Q water.
- Voeg met een finnpipet 10 ml 25% HNO_3 toe en vul aan met Milli-Q water tot 100 ml.

5.3 Handelingen

pH-meting

- Controleer de pH-meter met de pH 7 buffer. Zie voor het criterium paragraaf 5.5.
- Kalibreer de pH meter indien de controlemeting niet voldoet aan het criterium met pH 4 buffer en pH 10 buffer.
- Bepaal de pH van het monster. Zie voor het criterium paragraaf 5.5.
- Rapporteer, indien de pH voldoet aan het criterium de pH in het LIMS en ga verder met de volgende analyse.
- Wijk de pH af, breng het monster dan met resp. NaOH (te lage pH) danwel HNO_3 (te hoge pH) op de gewenste waarde. Maak hiervoor een keuze uit de volgende oplossingen. 0,33% NaOH, 3,3% NaOH, 0,25% HNO_3 danwel 2,5% HNO_3 .
- Breng hiertoe met een maatcilinder 100 ml monster over in een kunststof bekerglas van 250 ml en voeg in stappen 100 µl van genoemde oplossingen toe totdat de gewenste waarde is bereikt.
- Bereken aan de hand van de opgegeven tankinhoud de hoeveelheid toe te voegen 33% NaOH of 25% HNO_3 . Gebruik hiervoor de excelsheet "berekeningen".

Nummer: I 1.2.5-070
 Revisie: 04
 Datum: 07-08-2023
 Pagina: 4 van 12

UNL
 Instructie



Indien geprint, controleer of dit de laatste versie is

- Rapporteer het volume in LIMS. Voer geen verdere analyses uit aan dit monster en wacht op nieuw monstermateriaal.

Voorbehandeling monster analyse op α -, β - en γ -activiteit.

- Voeg aan het monster met een dispenser 30 ml 65% HNO_3 toe en homogeniseer.
- Plaats het monster tenminste 24 uur in een stoof bij 65 °C.
- Vul, na verwijdering uit de stoof, het nog warme monster in een kunststof monsterpot van 1 liter. Deze liter wordt gebruikt voor de analyse op γ -activiteit. De overgebleven hoeveelheid monster wordt gebruikt voor de analyse op α - en β -activiteit.
- Laat beide monsterpotten afkoelen tot kamertemperatuur.

Analyse op volumieke bepaling α - en β -activiteit.

- Reinig 9 RVS-afvalwaterplaten met scotch brite en een vloeibaar schuurmiddel, spoel na met iso-propanol.
- Voer de analyse in triplo uit. Gebruik 3 blanco afvalwaterplaten, 3 standaard afvalwaterplaten en 3 monster afvalwaterplaten. Plaats alle platen, na markeren met LIMS-ID, in de stoof bij 65 °C.
- Voer in triplo uit:
 Voeg met een maatcilinder 100 ml monster in een kunststof beker van 100 ml. Voeg een druppel vloeibare zeep toe en homogeniseer met het kunststof roerstaafje. Schenk deze oplossing uit op een monster afvalwaterplaat.
- Voer in triplo uit:
 Voeg met een maatcilinder 100 ml monster in een kunststof beker van 100 ml. Voeg een druppel zeep en 100 μl gecertificeerde uraan standaard (circa 200 Bq/ml ^{238}U) toe en homogeniseer met het kunststof roerstaafje. Schenk deze oplossing uit op een standaard afvalwaterplaat.
- Op de drie blanco afvalwaterplaten wordt geen vloeistof uitgegoten.
- Giet het resterende monster over in een 250 ml kunststof monsterpot met deksel.
- Laat de platen tenminste een nacht in de stoof liggen, totdat alle vloeistof is verdampt. De platen dienen volledig droog te zijn wanneer deze uit de stoof worden gehaald voordat tot analyse wordt overgegaan.
- Plaats de platen op de platenwisselaar. Het monster dat als eerste geanalyseerd dient te worden (= QC plaat voor) dient ook als eerste te worden geplaatst. De overige monsters worden bovenop de eerste plaat gelegd.
- Bouw de sequence op volgens onderstaande tabel.

Positie autosampler	Naam
11	QC plaat na
10	Blanco 3
9	Standaard 3
8	Standaard 2
7	Standaard 1
6	Blanco 2
5	Monster 3
4	Monster 2
3	Monster 1
2	Blanco 1
1	QC plaat voor

Nummer: I 1.2.5-070
 Revisie: 04
 Datum: 07-08-2023
 Pagina: 5 van 12

UNL Instructie



Indien geprint, controleer of dit de laatste versie is

- Analyseer de monsters. De te hanteren tijden zijn:
 Blanco: 300 minuten.
 Monster: 200 minuten.
 Standaard: 10 minuten.
 QC-analyse voor/na, 10 minuten.
- Bereken de α - en β -activiteit, met bijbehorende fout van de QC en de monsters in cpm. Deze berekening wordt uitgevoerd met behulp van de software van de gasdoorstroom detector.
- Print de meetdata.
- Rapporteer de resultaten van de QC's in LIMS. De software configureert automatisch een shewartkaart van de ingevoerde data. Controleer de QC aan de hand van de criteria genoemd in paragraaf 5.5.
- Rapporteer (bij goedkeuren QC) de resultaten van de monsters, inclusief bijbehorende fout, in LIMS.

Analyse op volumieke γ - activiteit

- Wikkel de 1 liter monsterfles in huishoudfolie.
- Plaats de monsterfles op het midden van de detector in het loodkasteel.
- Maak een nieuw monster aan in de APEX-software van de meetopstelling door te klikken op het icoon "sample".
- Geef bij "sample-ID" het LIMS-ID in.
- Geef bij "description" het tanknummer in.
- Klik in "procedure selection" op "afvalwater" en selecteer vervolgens "afvalwatermeting". Klik op "next".
- Geef "1" in bij "quantity" met als eenheid liters en klik vervolgens op "save".
- Start de analyse op het "main"-scherm. De tijd van de analyse bedraagt 100000 seconden.
- Na afloop van de analyse wordt het resultaat automatisch berekend en uitgeprint.
- Controleer in het rapport onder "interference corrected report" of radionucliden die gedefinieerd zijn in de nuclidenbibliotheek (bijlage 1) zijn aangetoond. Een nuclide wordt als aangetoond beschouwd indien de "nuclide id confidence" > 0,9 is en indien de "wt mean activity (Bq/liters)" hoger is dan de "nuclide MDA (Bq/liters)" in het "nuclide MDA rapport". Zie ook paragraaf 5.5.
- Voer de resultaten in LIMS in. Indien geen radionucliden worden aangetroffen wordt de minimale detectie voor ^{234}Th , zoals overeengekomen met het RIVM, ingevoerd. Indien wel een radionuclide wordt aangetroffen geef dan het resultaat in Bq/l in LIMS in met de in het rapport vermelde fout in %. Deze fout wordt met een betrouwbaarheidscoëfficiënt van $k = 2$ vermeld. Indien meer dan 1 radionuclide wordt aangetroffen, sommeer de activiteiten in Bq/l en bereken de bijbehorende fout, zie 5.4.1.
- Vermeld in LIMS bij lab info ook de aangetroffen radionucliden met de activiteit in Bq/l en de bijbehorende onzekerheid in Bq/l.

Rapportage

- Print in LIMS een formulier voor vrijgave van afvalwater (bijlage 3) uit en laat deze ondertekenen door de leidinggevende.
- Stuur een scan van het ondertekende formulier voor vrijgave van afvalwater naar Compliance UNL via e-mail.
- Archiveer de rapporten en ruwe data in de betreffende map.
- Print in LIMS de identificatiestickers (bijlage 2) uit en plak deze op de bij de gammaspectrometrische analyse gebruikte monsterspot en op de monsterpot met het resterende monster.
- Bewaar de monsters, ieder kwartaal worden de monsters overgedragen aan CS-EA.

Nummer: I 1.2.5-070
 Revisie: 04
 Datum: 07-08-2023
 Pagina: 6 van 12

UNL
 Instructie



Indien geprint, controleer of dit de laatste versie is

5.4 Berekeningen

5.4.1 γ -analyse

Berekening fout in de sommatie van radionucliden:

$$C_v = \frac{\sqrt{\sum S_{g,x}^2}}{\sum A_x} \times 100$$

C_v : Variatiecoëfficiënt behorende bij de sommatie van de aangetroffen radionucliden (%)
 $S_{g,x}$: Fout van de afzonderlijke gammastralers (Bq/l)
 A_x : Volumiek activiteit van de aangetroffen radionucliden (Bq/l)

5.4.2 α - en β -analyse

De hieronder beschreven berekeningen zijn van toepassing op zowel de α - en β -analyse.

Variatiecoëfficiënt in het telrendement:

De basis voor de berekening volgt uit de formule voor het berekenen van het telrendement.

$$\varepsilon = \frac{R_s - R_m}{A_s} = \frac{\Delta_1}{A_s} \Rightarrow \frac{S_\varepsilon}{\varepsilon} = \sqrt{\left(\frac{S_{\Delta_1}}{\Delta_1}\right)^2 + \left(\frac{S_{A_s}}{A_s}\right)^2}$$

ε : Telrendement ($s^{-1}Bq^{-1}$)
 R_s : Teltempo van de standaard (s^{-1})
 R_m : Teltempo van het monster (s^{-1})
 A_s : Activiteit van de toegevoegde standaard (Bq)
 Δ_1 : Netto teltempo van de standaard afvalwater (s^{-1})
 $\frac{S_\varepsilon}{\varepsilon}$: Variatiecoëfficiënt in het telrendement van de telopstelling
 $\frac{S_{\Delta_1}}{\Delta_1}$: Variatiecoëfficiënt van het teltempo van de standaard afvalwater
 $\frac{S_{A_s}}{A_s}$: Variatiecoëfficiënt van de toegevoegde standaard (= 0,025)

Standaarddeviatie van het netto teltempo van de standaard:

$$S_{\Delta_1} = \sqrt{(S_{R_s})^2 + (S_{R_m})^2}$$

S_{Δ_1} : Standaarddeviatie van het netto teltempo van de standaard afvalwater (s^{-1})
 S_{R_s} : Standaarddeviatie van de standaard afvalwater (s^{-1})
 S_{R_m} : Standaarddeviatie van het monster (s^{-1})

Nummer: I 1.2.5-070
 Revisie: 04
 Datum: 07-08-2023
 Pagina: 7 van 12

UNL
 Instructie



Indien geprint, controleer of dit de laatste versie is

Standaarddeviatie van de standaard afvalwater:

$$S_{R_s} = \frac{1}{\sqrt{n_s}} \times \sqrt{\frac{R_s}{t_s} + (f_{exp} \times R_s)^2}$$

S_{R_s} : Standaarddeviatie van de standaard afvalwater (s^{-1})
 n_s : Aantal resultaten van de standaard afvalwaterplaten waarover is gemiddeld
 R_s : Teltempo van de standaard afvalwater (s^{-1})
 t_s : Teltijd van de standaard afvalwater (s)
 f_{exp} : Experimentele variatiecoëfficiënt. Deze is voor $\alpha = 0,035$ en voor $\beta = 0,02$

Standaarddeviatie van het monster:

$$S_{R_m} = \frac{1}{\sqrt{n_m}} \times \sqrt{\frac{R_m}{t_m} + (f_{exp} \times R_m)^2}$$

S_{R_m} : Standaarddeviatie van het monster (s^{-1})
 n_m : Aantal resultaten van de monster platen waarover is gemiddeld
 R_m : Teltempo van het monster (s^{-1})
 t_m : Teltijd van het monster (s)
 f_{exp} : Experimentele variatiecoëfficiënt. Deze is voor $\alpha = 0,035$ en voor $\beta = 0,02$

Variatiecoëfficiënt van de volumieke activiteit:

De basis voor de berekening volgt uit de formule voor het berekenen van de volumieke activiteit inclusief de experimentele fout.

$$A_m = \frac{R_m - R_0}{\varepsilon \times V} = \frac{\Delta_2}{\varepsilon \times V} \Rightarrow \frac{S_{A_m}}{A_m} = k \sqrt{\left(\frac{S_{\Delta_2}}{\Delta_2}\right)^2 + \left(\frac{S_{\varepsilon}}{\varepsilon}\right)^2 + \left(\frac{S_V}{V}\right)^2} \times 100$$

A_m : Volumieke activiteit van het monster (Bq/l)
 ε : Telrendement van de telopstelling ($s^{-1}Bq^{-1}$)
 R_m : Teltempo van het monster (s^{-1})
 R_0 : Teltempo van de blanco (s^{-1})
 V : Opgebracht monstervolume (l)
 Δ_2 : Netto teltempo van het monster (s^{-1})
 $\frac{S_{A_m}}{A_m}$: Variatiecoëfficiënt van de volumieke activiteit
 k : Betrouwbaarheidscoëfficiënt ($k = 2$)
 $\frac{S_{\Delta_2}}{\Delta_2}$: Variatiecoëfficiënt van het netto teltempo van het monster
 $\frac{S_{\varepsilon}}{\varepsilon}$: Variatiecoëfficiënt van het telrendement van de telopstelling
 $\frac{S_V}{V}$: Variatiecoëfficiënt in het volume (=0,01)

Nummer: I 1.2.5-070
 Revisie: 04
 Datum: 07-08-2023
 Pagina: 8 van 12

UNL
 Instructie



Indien geprint, controleer of dit de laatste versie is

Standaarddeviatie van het netto teltempo van het monster:

$$S_{\Delta_2} = \sqrt{(S_{R_2})^2 + (S_{R_0})^2}$$

S_{Δ_2} : Standaarddeviatie van het netto teltempo van het monster (s^{-1})
 S_{R_2} : Standaarddeviatie van het monster (s^{-1})
 S_{R_0} : Standaarddeviatie van de blanco (s^{-1})

Standaarddeviatie van de blanco:

$$S_{R_0} = \frac{1}{\sqrt{n_0}} \times \sqrt{\frac{R_0}{t_0}}$$

S_{R_0} : Standaarddeviatie van de blanco (s^{-1})
 n_0 : Aantal resultaten van de monster afvalwater platen waarover is gemiddeld
 t_0 : Teltijd van de blanco (s)

Berekening van de laagst aantoonbare activiteit:

$$A_{\min} = \frac{k}{\varepsilon} \sqrt{\frac{R_{0,m}}{t_m} \times \left(1 + \frac{t_m}{t_{0,m}}\right)}$$

$A_{\min}$: Laagst aantoonbare activiteit van de afvalwaterplaten (Bq)
 $R_{0,m}$: Teltempo van de blanco (s^{-1})
 t_m : Meettijd van het monster (s)
 $t_{0,m}$: Meettijd van de blanco (s)
 k : Betrouwbaarheidscoëfficiënt ($k = 3$)
 ε : Telrendement van de opstelling

Laagste aantoonbare volumieke activiteit.

$$C_{A_{\min}} = \frac{A_{\min}}{V}$$

$C_{A_{\min}}$: Laagste aantoonbare volumieke activiteit van het monster (Bq/l)
 $A_{\min}$: Laagste aantoonbare activiteit van de afvalwaterplaten (Bq)
 V : Volume van het ingedampde monster (l)

Nummer: I 1.2.5-070
 Revisie: 04
 Datum: 07-08-2023
 Pagina: 9 van 12

UNL
 Instructie



Indien geprint, controleer of dit de laatste versie is

5.5 Kwaliteit

	Criterium
QC pH	6,9 < QC < 7,1
pH monster	6,5 < pH monster < 10,0
Accuracy gasdoorstroom detector	3s-grens controlekaart
Prestatie indicatoren germanium detector	3s-grens controlekaart
Nuclide id confidence	> 0,9
Aantoonbaarheidsgrens	Nuclide MDA ²³⁴ Th
Losingswaarde α-resultaat	< 75 kBq/m ³
Losingswaarde β- en γ-resultaat	< 800 kBq/m ³
Archiveringsduur analyseresultaten	5 jaar

Prestatiekenmerken gasdoorstroom detectoren vastgesteld in augustus 2023.

Detector	QC	Counts	RSD (%)
1U21	α-voor	3760	0,61
	α-na	3069	0,76
	β-voor	3014	0,71
	β-na	3731	0,55
1U62	α-voor	2312	0,85
	α-na	3023	0,87
	β-voor	2079	0,76
	β-na	2882	0,62

Prestatiekenmerken germanium detectoren vastgesteld in augustus 2023.

Detector	Parameter	Waarde	RSD (%)
1MA1	FWHM 105	0,626 keV	1,83
	FWHM 1274	1,609 keV	3,44
	Activiteit ¹⁵⁵ Eu	44505 Bq	1,42
	Activiteit ²² Na	51508 Bq	1,17
1U45	FWHM 105	0,579 keV	0,83
	FWHM 1274	1,708 keV	2,92
	Activiteit ¹⁵⁵ Eu	52940 Bq	2,29
	Activiteit ²² Na	52082 Bq	2,71

6 REFERENTIES

- Inleiding tot de stralingshygiëne.-Hoofdstuk 10-
A.J.J. Bos, F.S. Draaisma, W.J.C. Okx en C.E. Rasmussen.
- Excel-sheet "berekeningen"

8 Bijlage D Analyse van ventilatielucht door UNL

5 WERKWIJZE

De luchtstoffilters worden in enveloppen aangeleverd door CS-EA. Nadat minimaal 7 dagen zijn verstreken na de filterwisseling mogen de filters worden geanalyseerd. Vervolgens worden, na goedkeuring van de QC, de resultaten vrijgegeven.

Nummer: I 1.2.5-012
Revisie: 10
Datum: 23-03-2022
Pagina: 2 van 5

UNL
Instructie



Indien geprint, controleer of dit de laatste versie is

Uitvoering analyse

- Plaats de luchtstoffilters op een telplaat voor luchtstoffilters, met de bestoven kant naar boven. De met potlood beschreven kant is de onderkant.
- Plaats de platen op de platenwisselaar van de α/β -counter. Het monster dat als eerste dient te worden geanalyseerd (= QC-voor) dient ook als eerste te worden geplaatst. De overige monsters worden bovenop de eerste plaat gelegd.
- Bouw de sequeunce op volgens onderstaande tabel. Meet maximaal 5 monsters tussen 2 blanco's. Gebruik voor de blanco een ongebruikt glass fibre filter. Bij meer dan 5 monsters dienen extra blanco's te worden geanalyseerd.

Nummer: I 1.2.5-012
Revisie: 10
Datum: 23-03-2022
Pagina: 3 van 5

UNL
Instructie



Indien geprint, controleer of dit de laatste versie is

- Analyseer de monsters.
- Bereken de α - en β -activiteit, met bijbehorende fout van de QC en de monsters in cpm. Deze berekening wordt uitgevoerd met behulp van de FHT-8000 software.
- Print de meetdata.
- Rapporteer de resultaten van de QC's in LIMS. De software configureert automatisch een shewartkaart van de ingevoerde data. Controleer de QC aan de hand van de criteria genoemd in paragraaf 5.4
- Rapporteer (bij goedkeuren QC) de resultaten van de monsters, inclusief bijbehorende fout, in LIMS.

Documentatie

- De analysesresultaten worden gearhiveerd in de archiefmap behorende bij de FHT-8000.

9 Bijlage E RIVM schatting van radon exhalatie van UNL fabriekshallen; situatie in 2019

In de onderstaande tabel zijn de variabelen zoals door RIVM gedefinieerd in [14] toegepast op de genoemde UNL-fabriekshallen.

Tabel D1 Schatting van radonexhalatie in de bedrijfshallen SP4, SP5 en CSB.

variabelen (eenheid):	SP4	SP5 1MA	SP5 2MA	CSB
Area-beton (m^2)	6,00E+03	8,00E+03	6000	3150
Exhalatie-beton ($\text{Bq}\cdot\text{s}^{-1}$ per m^2)	5,00E-04	5,00E-04	5,00E-04	5,00E-04
Produktie-radon ($\text{Bq}\cdot\text{s}^{-1}$)	3,0	4,0	3,0	1,575
Flow door gebouw ($\text{m}^3\cdot\text{s}^{-1}$)	15	60	45	24,5
Deelflow door UNL-filter ($\text{m}^3\cdot\text{week}^{-1}$)	8000	1400	1400	14800
Deelflow door UNL filter ($\text{m}^3\cdot\text{s}^{-1}$)	0,0132	0,0023	0,0023	0,0245
Deelflow door geponst filter ($\text{m}^3\cdot\text{week}^{-1}$)	480	85	85	530
Deelflow door geponst filter ($\text{m}^3\cdot\text{s}^{-1}$)	0,00079	0,00014	0,0001	0,0009
Volume van gebouw (m^3)	4,46E+05	3,20E+05	2,40E+05	64512
Ventilatievoud (s^{-1})	3,43E-05	1,88E-04	1,88E-04	3,79E-04
Lambda radon (s^{-1})	2,10E-06	2,10E-06	2,10E-06	2,10E-06
lambda ^{210}Pb (s^{-1})	1,00E-09	1,00E-09	1,00E-09	1,00E-09
lambda ^{210}Po (s^{-1})	5,80E-08	5,80E-08	5,80E-08	5,80E-08
Act Rn ($\text{Bq}\cdot\text{m}^{-3}$)	3,2	3,1	3,1	3,1
Act Rn-buiten ($\text{Bq}\cdot\text{m}^{-3}$)	3,0	3,0	3,0	3,0
Conc radondochters ($\text{N}\cdot\text{m}^{-3}$)	9,32E+04	1,64E+04	1,64E+04	8,08E+03
Act (^{210}Pb) [$\text{Bq UNL-filter, week}^{-1}$]	0,75	0,02	0,02	0,12
RIVM-filter ($\text{mBq}\cdot\text{week}^{-1}$)	44,7	1,4	1,4	4,3
RIVM-filter (berekend $\text{mBq}\cdot\text{m}^{-3}$)	0,09	0,016	0,016	0,008
RIVM-filter (gemeten $\text{mBq}\cdot\text{m}^{-3}$)	0,03 - 0,5	< 0,11	< 0,12	0,03 - 3,5

* Gegevens voor SP5 aangeleverd door UNL:

Flow door gebouw = $54000 \text{ m}^3\cdot\text{h}^{-1}$ per hal

SP5 filter 1 betreft 4 hallen

SP5 filter 2 betreft 3 hallen (situatie 2019).

Betonoppervlak SP5 is $\sim 2000 \text{ m}^2$ per hal

Deelflow door SP5 UNL-filter : $1400 \text{ m}^3\cdot\text{week}^{-1}$.

Referenties

- 1 NEN-EN-ISO 17025. Algemene eisen voor de bekwaamheid van beproevings- en kalibratielaboratoria. NEN, Delft, 2018.
- 2 a) S. Hofmann. K. Schmidt, C. Wittwer. *Abwasser aus kerntechnischen Anlagen, Ringversuch 2023*, November 2023, Bundesamt für Strahlenschutz, Duitsland, www.bfs.de.
b) S. Hofmann. K. Schmidt, C. Wittwer. *Abwasser aus kerntechnischen Anlagen, Ringversuch 2024*, December 2024, Bundesamt für Strahlenschutz, Duitsland, www.bfs.de.
- 3 BfS, 45. Ringversuch "Fortluft 2023"; BfS report BfS-UR 3-71/2024, augustus 2024.
- 4 A3.1 Ondersteuning Inspectie en Monitoring, Contra expertise metingen nucleaire installaties. M/390220/23/SM – Jaarplan 2023; aangepaste versie op 12-1-2023 akkoord bevonden.
- 5 NEN-EN-ISO 20042. Measurement of radioactivity - Gamma-ray emitting radionuclides - Generic test method using gamma-ray spectrometry.
- 6 NEN 5636. Radioactiviteitsmetingen. Bepaling van de kunstmatige totaal alfa-, kunstmatige totaal bèta-activiteit en gammaspectrometrie van luchtfilters en berekening van de volumieke activiteit van de bemonsterde lucht. NEN, Delft.
- 7 Prestatiekenmerken van een eigen methode : De bepaling van totaal-alfa en totaal-bèta in afvalwater. GJ Knetsch, juli 2007, Laboratorium voor Stralingsonderzoek, RIVM (niet openbaar).
- 8 Kwakman PJM. Contra expertise op bepalingen van radioactiviteit van afvalwater en ventilatielucht van Urenco Nederland B.V. Periode 2022. RIVM rapport 2023-0388.
- 9 KTA 1503.1. Überwachung der Ableitung gasförmiger und an Schwebstoffen gebundener radioaktiver Stoffe. Teil 1: Überwachung der Ableitung radioaktiver Stoffe mit der Kaminfortluft bei bestimmungsgemäßem Betrieb, KTA, 2022-11.
- 10 KTA 1504. Überwachung der Ableitung radioaktiver Stoffe mit Wasser. KTA, 2022-11.
- 11 NEN 1047. Receptbladen voor de statistische verwerking van waarnemingen. NEN, Delft 1991.
- 12 ISO/IEC Guide 98-1:2024 Guide to the expression of uncertainty in measurement.
- 13 Urenco Nederland B.V. Rapportage Lucht- en waterlozingen: 2023 kwartaal 1 en 2, COM/23/1615A, 24 april 2024 (aangepaste rapportage na eerdere incomplete rapportage) 2023 kwartaal 3 en 4, COM/24/0608, 28 maart 2024. 2024 kwartaal 1 en 2, COM/24/1709, 30 sept 2024. 2024 kwartaal 3 en 4, COM/25/0655, 31 maart 2025.
- 14 Kwakman PJM en P. Stoop. Evaluatie van controlemetingen door het RIVM van luchtzijdige emissies van Urenco Nederland B.V. RIVM/LSO rapport 231/04.
- 15 Basisdocument Radon. LH Vaas, et al., RIVM rapport 710401014, Bilthoven

Dit is een uitgave van:

**Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu**

Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven
www.rivm.nl

juli 2025

De zorg voor morgen
begint vandaag